Medical Way

di Roberto Spano

GIUGNO 2022

MANIPOLI pag. 4

INSERTI pag. 18

MATERIALI DA OTTURAZIONE pag. 48

DISINFEZIONE & IGIENE pag. 60

www.medicalway.it

La Medical Way è un' azienda
nata con l'intento
di mettere in contatto i produttori con i clienti finali
evitando passaggi a volte inutili e dispendiosi.

Il 90% dei prodotti trattati
vengono direttamente
dai produttori mantenendo
una qualità costante
ed una rapida ed efficace consulenza tecnica
in caso di necessità.

Roberto Spano

MANIPOLI

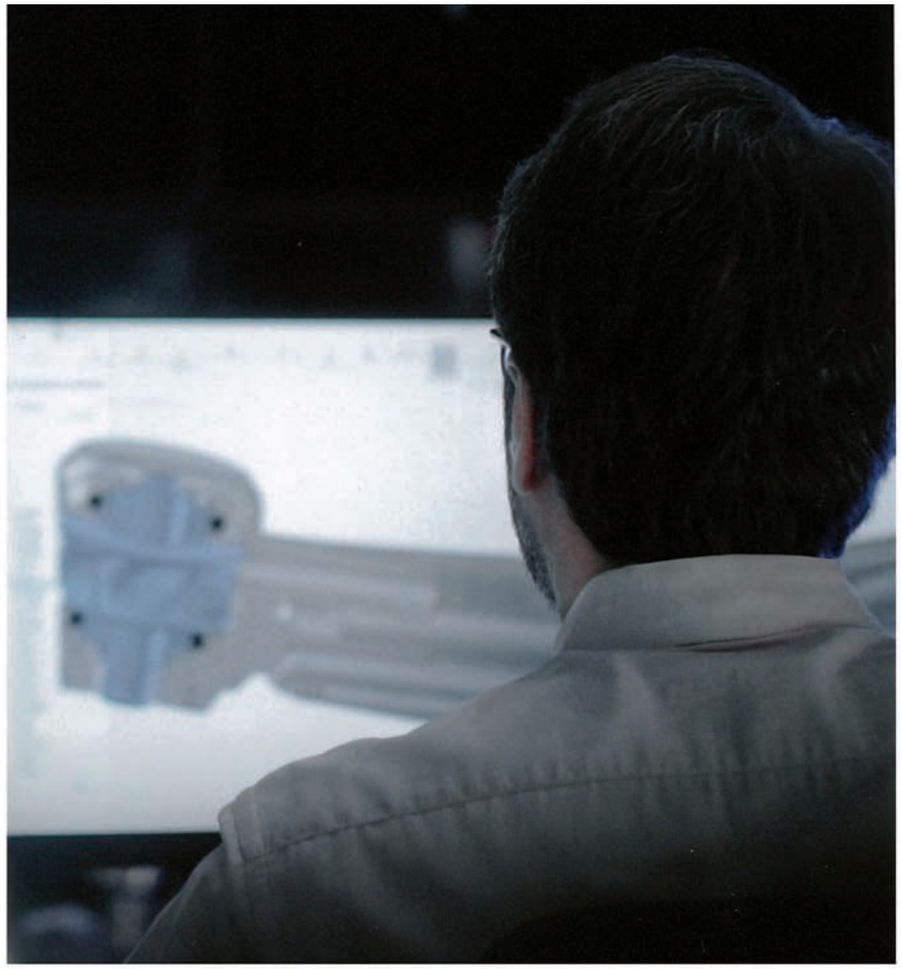

Since our founding in 1995 in Germany, MK-dent has grown into one of the leading manufacturers of dental instruments. Today, our meticulously crafted precision instruments are available in more than 110 countries around the world, through a distribution network of approximately 800 authorized dealers. At MK-dent, we are solving today's most important problems in dentistry. We ignite opportunity by building better dental products and helping millions of patients suffering from oral diseases worldwide.

In Pursuit of Excellence: What does it take to make a masterpiece?

To celebrate the company's 25th anniversary, we are launching the global campaign "In Pursuit of Excellence". At MK-dent, to achieve a masterpiece demands a cohesive team of talented technicians, engineers and craftspeople with a commitment to core values and pushing boundaries. In their pursuit of excellence, they strive for precise detail at every level of their work.

ECO LINE TURBINE
HE21 WITH LIGHT, STANDARD HEAD

COUPLING TYPES: KAVO, NSK, SIRONA, W&H
HEAD SIZE (MM): Ø 12.5 X H 14.3
POWER (W): UP TO 24
SOUND LEVEL (DB): MAX. 62
SPRAY OUTLET: 4 ASYMETRICAL MIXED
WEIGHT (G): 62
WARRANTY (MONTHS): 18

ECO LINE TURBINE
HE22 WITH LIGHT, SMALL HEAD

COUPLING TYPES: KAVO, NSK, W&H
HEAD SIZE (MM): Ø 10.8 X H 12.5
POWER (W): UP TO 16
SOUND LEVEL (DB): MAX. 62
SPRAY OUTLET: 3 ASYMETRICAL MIXED
WEIGHT (G): 60
WARRANTY (MONTHS): 18

COUPLING
WITH LIGHT

COUPLING TYPES: KAVO, SIRONA, NSK, W&H
LIGHT: LED OR XENON
COLOR TEMPERATURE: 5,500K
TUBING PINS: 6
WATER REGULATION: V
COATING: TITANIUM OR CHROME
WEIGHT (G): 30
WARRANTY (MONTHS): 24

COUPLING
WITHOUT LIGHT

COUPLING TYPES: KAVO, SIRONA, NSK, W&H
LIGHT: —
COLOR TEMPERATURE: —
TUBING PINS: 6-, 4- OR 2
WATER REGULATION: —
COATING: CHROME
WEIGHT (G): 30
WARRANTY (MONTHS): 24

ECO LINE CONTRA-ANGLE
LE15L WITH LIGHT, LE15 W/O LIGHT

1:5 CAVITY PREPARTION

COUPLING TYPE: ISO
HEAD SIZE (MM): Ø 10.3 X H 15.1
USABLE BURS: FG-BURS (Ø 1.6 MM)
SPRAY OUTLET: 3 ASYMETRICAL MIXED
NON-LOAD SPEED (RPM): 200 000
WEIGHT (G): 80
WARRANTY (MONTHS): 24

ECO LINE CONTRA-ANGLE
LE11L WITH LIGHT, LE11 W/O LIGHT

1:1 FINISHING & POLISHING

COUPLING TYPE: ISO
HEAD SIZE (MM): Ø 9.8 X H 14.3
USABLE BURS: CA-BURS (Ø 2.35 MM)
SPRAY OUTLET: 1 ASYMETRICAL MIXED
NON-LOAD SPEED (RPM): 40 000
WEIGHT (G): 80
WARRANTY (MONTHS): 24

ECO LINE CONTRA-ANGLE
LE16L WITH LIGHT, LE16 W/O LIGHT

1:1 FINISHING & POLISHING

COUPLING TYPE: ISO
HEAD SIZE (MM): Ø 9.8 X H 14.8
USABLE BURS: FG-BURS (Ø 1.6 MM)
SPRAY OUTLET: 1 ASYMETRICAL MIXED
NON-LOAD SPEED (RPM): 40 000
WEIGHT (G): 80
WARRANTY (MONTHS): 24

ECO LINE HANDPIECE
LE01L WITH LIGHT

1:1 PREPARATION

COUPLING TYPE: ISO
HEAD SIZE (MM): -
USABLE BURS: HP-BURS (Ø2.35MM)
SPRAY OUTLET: 1 ASYMETRICAL MIXED
NON-LOAD SPEED (RPM): 40 000
WEIGHT (G): 100
WARRANTY (MONTHS): 24

ECO LINE HANDPIECE
LE01 WITHOUT LIGHT

1:1 PREPARATION

COUPLING TYPE: ISO
HEAD SIZE (MM): -
USABLE BURS: HP-BURS (Ø2.35MM)
SPRAY OUTLET: 1 ASYMETRICAL MIXED
NON-LOAD SPEED (RPM): 40 000
WEIGHT (G): 100
WARRANTY (MONTHS): 24

BASIC LINE HANDPIECE
LB01W WITHOUT LIGHT

1:1 PREPARATION

COUPLING TYPE: ISO
HEAD SIZE (MM): Ø 8.0 X H 13.3
USABLE BURS: HP-BURS (Ø 2.35 MM)
SPRAY OUTLET: EXTERNAL
NON-LOAD SPEED (RPM): 40 000
WEIGHT (G): 88
WARRANTY (MONTHS): 12

AIR MOTOR

SPRAY: INTERNAL OR EXTERNAL
COATING: TITANIUM OR CHROME
LIGHT: LED AVAILABLE
COLOR TEMPERATURE: 5,500K
NON-LOAD SPEED (RPM): 20 000
DIRECTION OF ROTATION: LEFT AND RIGHT
WEIGHT (G): 80
WARRANTY (MONTHS): 24

MK-DENT SYNTHETIC OIL

MACCHINA IMPLANTARE

C-SAILOR PRO

PEDALE MULTIFUNZIONE

GRANDE DISPLAY TOUCH

CARATTERISTICHE MACCHINA IMPLANTARE:
- GRANDE DISPLAY TOUCH
- INTERVALLO DI VELOCITÀ 300 ~ 40.000 RPM
- PEDALE MULTIFUNZIONE
- TORQUE MAX 80NCM
- MOTORE CHIRURGICO AD INDUZIONE
- VALIGIA IN ALLUMINIO

CARATTERISTICHE CONTRANGOLO:
- RAPPORTO 20:1
- FIBRA OTTICA
- SISTEMA A PULSANTE
- TORQUE MAX 55NCM

Medical Way

IPR FILE SYSTEM



Reciprocating Stroke of 1.6mm

Complex ITSTM Contra-Angle Handpiece compact design makes searching posterior regions easy

Use with most standard slow-speed Air Motors & compressed air unit

IPR GAUGE

Used during Inter proximal Reduction (IPR) to measure and confirm space.

Includes seven gauges:

- 0.10mm
- 0.15mm
- 0.20mm
- 0.25mm
- 0.30mm
- 0.40mm
- 0.50mm
- Stainless steel
- Autoclavable

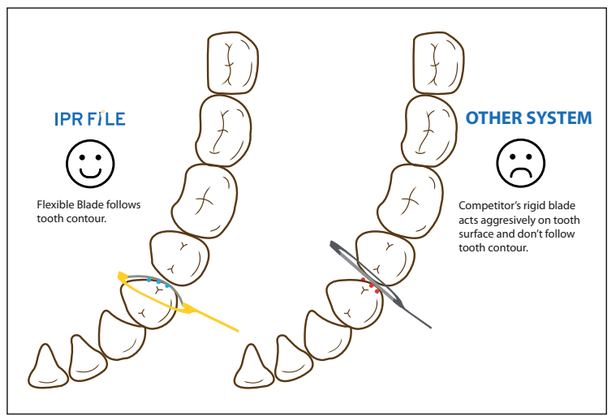

Inter Proximal Reduction(IPR)

Stripping Protocols in Orthodontics require a wide selection of mechanical or manual instruments for opening contact points, enamel reduction and finishing proximal surfaces. Our IPR File system provides efficient tools for Stripping, which are ergonomically and practically arranged for the treatment of each patient.

IPR SET

Contact Breaker

Handheld laser welded blades are provided for opening proximal spaces in crowded cases. Available in 50µm and 100µm

Manual Stripping

Two handles (90° & 45°)are provided for efficient manual space creation.

EJECTOR

- Conical tool for ergonomix release of strips from Contra -angle. This also enhances the life and grip of the hand piece.
- To facilitate release of the strips from the contra-angle in between the various Stripping phases.

Price List	Master Kit	Starter Kit	Packaging	Ref #	Usage
Reciprocating Contra Handpiece	Present	Present	Ea	-	-
Thickness Guage	Present	Present	7 guages	-	-
Conical Tool	Present	Present	Ea	-	-
Manual Handle Straight	Present	-	Ea	-	-
Manual Handle Angled	Present	-	Ea	-	-
Contact Breaker (50 µm)	Present	-	Ea	-	-
Contact Breaker (100 µm)	Present	-	Ea	-	-
IPR Blade (Set)			Assort. Of 12	-	-
White (Saw)(100µm)	8 pcs	2 pcs	Pair	100-424	10 µm serrated edge for opening contact points to facilitate entry of other files.
Yellow (Single Side) (90µm)	4L + 4R	1L + 1R	Pair	100-C304L 100-C304R	90 µm single sided abrasive file for initial reduction in crowded cases & final polishing.
Blue (Single Sided) (100µm)	4L + 4R	1L + 1R	Pair	100-304L 100-304R	100 µm single sided abrasive file for additional reduction in crowded case & pre-polishing.
Purple (Single Sided) (150µm)	4L + 4R	1L + 1R	Pair	100-G304L 100-G304R	150 µm single sided abrasive file for main reduction.
Blue (Double Sided) (200µm)	8 pcs	2 pcs	Pair	100-314	200 µm double sided abrasive file for contouring.
Black (Double Sided)(300µm)	8 pcs	2 pcs	Pair	100-G314	300 µm double sided abrasive file for high enamel reduction.

ENDODONZIA

C SMART-MINI AP

MADE PRC

- MOTORE ENDODONTICO WIRELESS CON RILEVATORE APICALE INTEGRATO
- VELOCITA' 150-600 GIRI/MIN
- TORQUE 0.6/4.0 NCM
- CALIBRAZIONE AUTOMATICA DEL TORQUE
- OTTO MOVIMENTI RECIPROCANTI IMPOSTABILI
- DISPLAY LCD
- IMPOSTATO PER I MAGGIORI FILE DI UTILIZZO

C SMART-1 PRO

MADE PRC

- AMPIO SCHERMO LCD A COLORI • COMANDO A PULSANTE DI FACILE UTILIZZO • LOCALIZZATORE APICALE INCLUSO
- SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A LED SEPARABILE PER UNA MIGLIORE VISIBILITÀ OPERATIVA
- MICROMOTORE COMPATIBILE CON TESTINA ENDO MATE NSK 16:1
- IL MOTORE DI PRECISIONE E LA TECNOLOGIA DI MISURAZIONE DELL'IMPEDENZA RADICOLARE IN TEMPO REALE INCLUDE LE SPECIFICHE AUTOMATIZZATE PER L'USO CON I PRINCIPALI SISTEMI DI ESPANSIONE DEI CANALI RADICOLARI, COME DENTSPLY® WAVE ONE VDW® RECIPROC®, SENZA NECESSITÀ DI SET UP
- BATTERIA RICARICABILE A IONI DI LITIO AD ALTA CAPACITÀ
- TORQUE: 0.6-4.0 NCM • VELOCITÀ DI ROTAZIONE: 100-650 GIRI/MIN.

ABLATORI & PIEZO

SONIC L

MADE PRC

• FIBRA OTTICA • COMPLETO DI 3 INSERTI E CHIAVE DINAMOMETRICA • CON REGOLATORE DI POTENZA • **COMPATIBILE ATTACCO KAVO**

SONIC K

MADE PRC

• SENZA FIBRA OTTICA • COMPLETO DI 3 INSERTI E CHIAVE • **COMPATIBILE ATTACCO KAVO**

PROPHY LINE

360°
360° NOZZLE

SYNTHETIC MATERIAL HOUSING

PLUG AND PLAY

135°C
STERILISABLE AND THERMODISINFECTABLE [1]

COUPLING TYPE: BIEN-AIR, KAVO, NSK, SIRONA, W&H **MATERIAL HOUSING:** SYNTHETIC **MIN. POWDER CONSUMPTION VOLUME (G):** 4 **MIN. WATER FLOW (ML):** 45 **MIN. AIR FLOW VOLUME (L):** 12 **WARRANTY (MONTHS):** 24

INSERTI

INSERTI

EMS
EMS EMS

SIRONA
SIR SIR

NSK
NSK NSK

DIAMANTATA

IRRIGAZIONE

SAT SAT
SATELEC

MEC MEC
MECTRON

INSERTI

COMPATIBILITA' EMS SAT SIR MEC NSK

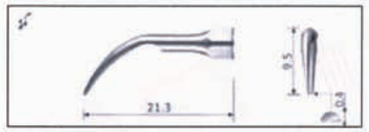

ABLAZIONE

G1 GD1 GM1 GN1

UTILIZZATA PER RIMUOVERE LEGGERI DEPOSITI DI TARTARO E PLACCA SOPRA-GENGIVALE.

ABLAZIONE

G2 GD2

BORDO PIATTO UTILIZZATO PER RIMUOVERE SPESSI DEPOSITI DI TARTARO SOPRA-GENGIVALE.

ABLAZIONE

G3 GD3 GS3 GM3 GN3

UTILIZZATA PER RIMUOVERE TARTARO E PLACCA SOPRA-GENGIVALE NELL'AREA INTERDENTALE

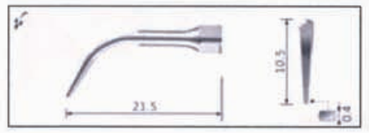

ABLAZIONE

G4 GD4 GS4 GM4 GN4

UTILIZZATA PER RIMUOVERE TUTTO IL TARTARO E LA PLACCA SOPRA-GENGIVALE

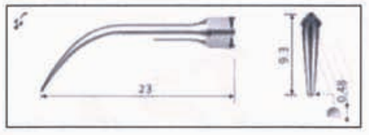

ABLAZIONE

G5 GD5 GM5

UTILIZZATA PER RIMUOVERE TUTTO IL TARTARO E LA PLACCA SOPRA-GENGIVALE

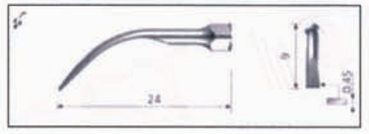

ABLAZIONE

GM6

UTILIZZATA PER RIMUOVERE SPESSI DEPOSITI DI TARTARO SOPRA-GENGIVALE

PERIO

P1 PD1 PM1 PN1

UTILIZZATA PER RIMUOVERE IL TARTARO SOTTO-GENGIVALE

PERIO

P3 PD3 PS3 PM3 PN3

UTILIZZATA PER RIMUOVERE IL TARTARO SOTTO-GENGIVALE

INSERTI

COMPATIBILITA' EMS SAT SIR MEC NSK

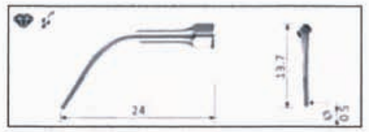

PERIO

P3D PD3D

RIVESTIMENTO DIAMANTATO, UTILIZZATA PER LEVIGARE LA SUPERFICIE DELLA RADICE DURANTE LA CHIRURGIA PERIODONTALE DEL LEMBO

PERIO

P4 PD4 PS4

UTILIZZATA PER RIMUOVERE IL TARTARO SOTTO-GENGIVALE

ENDO

E1 ED1 ES1 EN1

SUPPORTO ANGOLARE A 120° PER FILE A U CON DIAMETRO DELLO STELO DI 0,57 MM, QUESTO INSERTO È USUALMENTE UTILIZZATO PER LA PULIZIA DEL CANALE RADICOLARE ANTERIORE

ENDO

ED2

SUPPORTO ANGOLARE A 95° PER FILE A U CON DIAMETRO DELLO STELO DI 0,57 MM, QUESTO INSERTO È USUALMENTE UTILIZZATO PER LA PULIZIA DEL CANALE RADICOLARE MOLARE

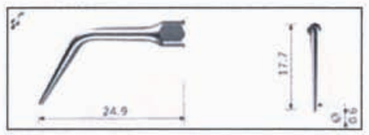

ENDO

E3 ED3

DISABILITANDO LO SPRAY REFRIGERANTE QUESTO PUNTALE VIENE UTILIZZATO PER LA CONDENSAZIONE TERMICA LATERALE DELLA GUTTAPERCA

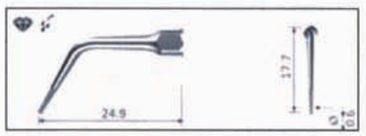

ENDO

E3D ED3D

RIVESTIMENTO DIAMANTATO, UTILIZZATA PER RIMUOVERE IL MATERIALE MALATO DALLA CAVITÀ DELLA POLPA.

ENDO

E4 ED4 ES4

RIMUOVE RAPIDAMENTE LE OSTRUZIONI E GLI OSTACOLI NELLA METÀ E NELLA TERZA PARTE SUPERIORE DEI CANALI GRANDI E DRITTI

ENDO

ED5

UTILIZZATA PER RIMUOVERE RAPIDAMENTE IL TARTARO E CEMENTI TEMPORANEI

INSERTI

COMPATIBILITA' EMS

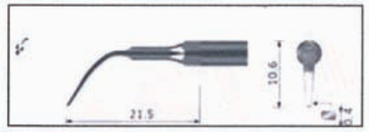

ABLAZIONE E PERIO

eA

UNIVERSALE. RIMOZIONE ACCURATA DI DEPOSITI SOLIDI SOPRA-GENGIVALI IN TUTTI I QUADRANTI

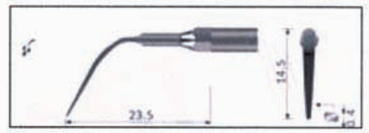

ABLAZIONE E PERIO

eP

PERIO. LO STRUMENTO P È ADATTO PER RIMUOVERE CON PRECISIONE DEPOSITI DI TARTARO E CONCREZIONI MOLTO DURE SOPRA-GENGIVALI E SOTTO-GENGIVALI IN TUTTI I QUADRANTI.

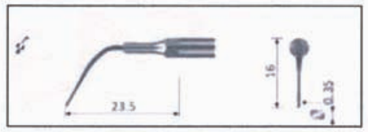

ABLAZIONE E PERIO

ePS

PERIOSLIM. IL PIÚ VELOCE E POCO INVASIVO STRUMENTO PS, È L' IDEALE PER RIMUOVERE I DEPOSITI NELLE TASCHE PERIODONTALI PROFONDE IN TUTTI I QUADRANTI.

PULIZIA IMPIANTO

eICP SET

PULIZIA IMPIANTI. SET COMPOSTO DA: **CHIAVE, INSERTO E DUE PEEK**
INSERTO PEEK PER UNA SICURA E GENTILE PULIZIA DEGLI IMPIANTI E RESTAURI.

PULIZIA IMPIANTO

ICPpeek

RICAMBIO. PEEK CONFEZIONE DA 10

INSERTI

COMPATIBILITA' **SAT**

ABLAZIONE

s#1

UNIVERSALE. ABLAZIONE SEMPLICE SOPRA-GENGIVALE E RIMOZIONE DEL TARTARO SENZA DANNEGGIARE LO SMALTO.

ABLAZIONE

s1S

SLIM. ABLAZIONE SOPRA E SOTTO-GENGIVALE. PARTICOLARMENTE EFFICACE NEGLI SPAZI INTERPROSSIMALI

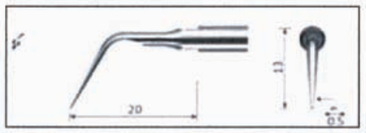

PERIO

s10X

INTERPROSSIMALE. LA SUA PARTE ATTIVA PIATTA LO RENDE ADATTO AGLI SPAZI INTERPROSSIMALI E AL RIDIMENSIONAMENTO SOPRA-GENGIVALE. IL SUO DESIGN ANATOMICO CONSENTE UN USO RAPIDO ED EFFICIENTE.

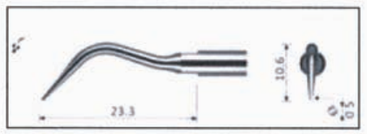

PERIO

s10P

POCA PROFONDITA'. STRUMENTO ROTONDO SOTTILE ADATTO PER L'ABLAZIONE SUPERFICIALE DELLE TASCHE PROFONDE MENO DI 2-3MM.

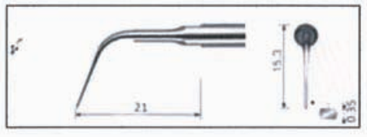

PERIO

s10Z

SOTTO GENGIVALE. TASCHE MEDIE (<4MM). RIMOZIONE DEL BIOFILM E DEPOSITI SOFFICI, CONSENTE L'OSSERVAZIONE DELLA PROFONDITÀ DELLE TASCHE UTILIZZANDO LA SCALA DA 3 MM

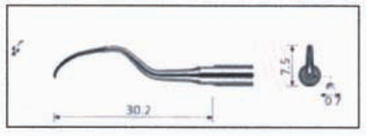

PERIO

sH3

PERIODONTOLOGIA ANTERIORE. ADATTO AL TRATTAMENTO DEL BLOCCO INCISIVO-CANINO. IL BORDO DI GUIDA È ORIENTATO PARALLELAMENTE ALLA TASCA. ADATTO AL LAVORO NELLA TASCA PERIODONTALE SENZA LEDERE I LEGAMENTI.

INSERTI

COMPATIBILITA' **SAT**

ENDO

sET40D

DIAMANTE. INSERTO IN ACCIAIO CON RIVESTIMENTO DIAMANTATO PER IL TRATTAMENTO DI MATERIA MOLTO DURA NEL TERZO MEDIO. LUNGHEZZA 40MM. 30UM DIAMANTI, RASTREMAZIONE 4%

ENDO

sTK1L

SONDA ESTESA. IDEALE PER L'ESAME E IL MANTENIMENTO DELLE TASCHE MEDIO-PROFONDE (>4MM). UN AUSILIO DIAGNOSTICO UTILIZZATO DURANTE IL DEBRIDEMENT E L'IRRIGAZIONE DELLE TASCHE

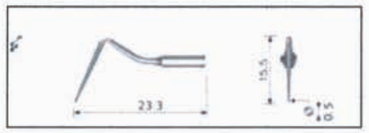

ENDO

sTK1S

SONDA. RACCOMANDATA PER L'ESAME DELLE TASCHE POCO E MEDIO PROFONDE (<4MM) E PER IL MANTENIMENTO DI CASI SEMPLICI. TK1-1S È UN INSERTO GRADUATO OGNI 3MM.

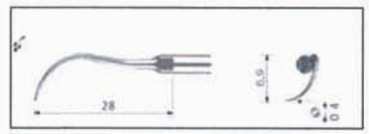

ENDO

sTK2L

MANTENIMENTO ORIENTAMENTO SINISTRA. RACCOMANDATA PER IL MANTENIMENTO DI TASCHE MODERATAMENTE PROFONDE E LE BIFORCAZIONI. EQUIVALENTE ALLA SONDA NABERS

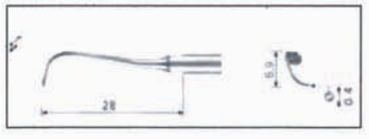

ENDO

sTK2R

MANTENIMENTO ORIENTAMENTO DESTRA. COMPAGNA DELLA S-TK2-1L. RACCOMANDATA PER IL MANTENIMENTO DI TASCHE MODERATAMENTE PROFONDE E LE BIFORCAZIONI. EQUIVALENTE ALLA SONDA NABERS

PULIZIA IMPIANTO

sICP SET

PULIZIA IMPIANTI. SET COMPOSTO DA: **CHIAVE, INSERTO E DUE PEEK** INSERTO PEEK PER UNA SICURA E GENTILE PULIZIA DEGLI IMPIANTI E RESTAURI.

PULIZIA IMPIANTO

ICPpeek

RICAMBIO. PEEK CONFEZIONE DA 10

INSERTI

COMPATIBILITA' **NSK**

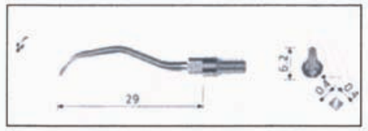

nS1

UNIVERSALE. RIMOZIONE DEL TARTARO MARGINALE E SOPRA-GENGIVALE.

ABLAZIONE AD ARIA

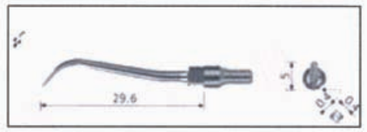

nS2

PERIO. RIMOZIONE DEL TARTARO SOPRA-GENGIVALE

ABLAZIONE AD ARIA

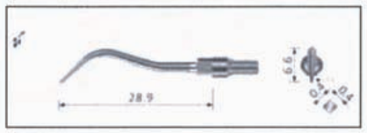

nS3

FALCE. RIMOZIONE DEL TARTARO SOPRA-GENGIVALE

ABLAZIONE AD ARIA

NK5

INSERTO PER LA PULIZIA DELLE RADICI, APPLICAZIONE DRITTA.

ABLAZIONE AD ARIA

nSICP SET

PULIZIA IMPIANTI. SET COMPOSTO DA: **CHIAVE, INSERTO E DUE PEEK**
INSERTO PEEK PER UNA SICURA E GENTILE PULIZIA DEGLI IMPIANTI E RESTAURI.

PULIZIA IMPIANTO

ICPpeek

RICAMBIO. PEEK CONFEZIONE DA 10

PULIZIA IMPIANTO

INSERTI

COMPATIBILITA' **SIRONA**

sr1L

GENERALE. STRUMENTO A PUNTA PIATTA PER ABLAZIONE INIZIALE.

ABLAZIONE

sr2L

VERSATILE. STRUMENTO VERSATILE UTILIZZATO PER ABLAZIONE APPROSSIMALE.

ABLAZIONE

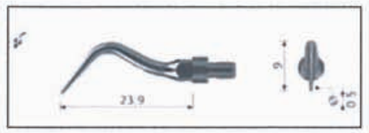

sr3L

INTERDENTALE. STRUMENTO UNIVERSALE CHE PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER ABLAZIONE SOPRA-GENGIVALE E SPAZI INTERDENTALI.

ABLAZIONE

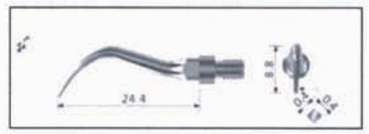

sr4L

STRUMENTO IDEALE PER LA SUPERFICIE DENTALE SOPRA-GENGIVALE E SOTTO-GENGIVALE E LE AREE INTERDENTALI

ABLAZIONE

srICP SET

PULIZIA IMPIANTI. SET COMPOSTO DA: **CHIAVE, INSERTO E DUE PEEK**
INSERTO PEEK PER UNA SICURA E GENTILE PULIZIA DEGLI IMPIANTI E RESTAURI.

PULIZIA IMPIANTO

ICPpeek

RICAMBIO. PEEK CONFEZIONE DA 10

PULIZIA IMPIANTO

INSERTI

COMPATIBILITA' KAVO

SONICFLEX

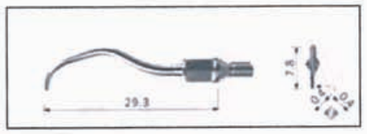

k#5 **(GK1)**

GENERALE. RIMOZIONE DEL TARTARO DA TUTTE LE SUPERFICI DEI DENTI

SONICFLEX

k#6

SOTTILE. STRUMENTO SOTTILE PER LE AREE PIÙ PICCOLE E DI PIÙ DIFFICILE ACCESSO

SONICFLEX

k#7 **(GK3)**

SOTTO-GENGIVALE. STRUMENTO UTILIZZATO PER L'ABLAZIONE SOTTO-GENGIVALE.

SONICFLEX

k#8 **(GK4)**

SOTTO-GENGIVALE. RIMOZIONE DEL TARTARO SOTTO-GENGIVALE

SONICFLEX

k#60

PUNTA LUNGA DRITTA CON SUPERFICI ARROTONDATE, LA K#60 VIENE UTILIZZATA PER UNA PULIZIA DELICATA DELLE TASCHE DURANTE IL TRATTAMENTO PERIODONTALE. E' EFFICACE PER LA PULIZIA NELLE TASCHE FINO AI 9MM DI PROFONDITÀ. UTILIZZATA NELLE REGIONI ANTERIORI, SUPERFICI LISCE.

SONICFLEX

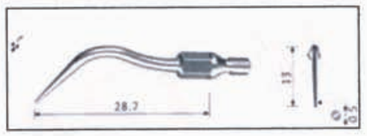

GK5

UTILIZZATA PER LA RIMOZIONE DEL TARTARO SOPRA-GENGIVALE E SOTTO-GENGIVALE

PULIZIA IMPIANTO

kICP SET

PULIZIA IMPIANTI. SET COMPOSTO DA: **CHIAVE, INSERTO E DUE PEEK**
INSERTO PEEK PER UNA SICURA E GENTILE PULIZIA DEGLI IMPIANTI E RESTAURI.

PULIZIA IMPIANTO

ICPpeek

RICAMBIO. PEEK CONFEZIONE DA 10

INSERTI

COMPATIBILITA' KAVO

SONICFLEX QUICK 2008

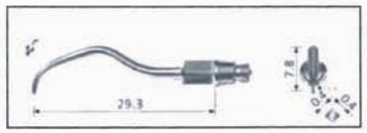

k5A

GENERALE. RIMOZIONE DEL TARTARO DA TUTTE LE SUPERFICI DENTALI

SONICFLEX QUICK 2008

k6A

SOTTILE. STRUMENTO SOTTILE PER LE AREE PIU' PICCOLE E DI PIU' DIFFICILE ACCESSO

SONICFLEX QUICK 2008

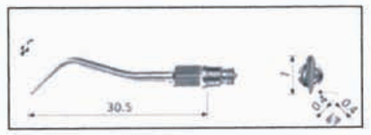

k7A

SOTTO-GENGIVALE. STRUMENTO UTILIZZATO PER L'ABLAZIONE SOTTO-GENGIVALE

SONICFLEX QUICK 2008

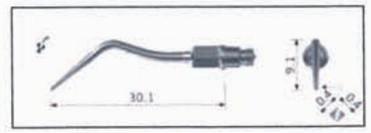

k8A

SOTTO-GENGIVALE. RIMOZIONE DEL TARTARO SOTTO-GENGIVALE

SONICFLEX QUICK 2008

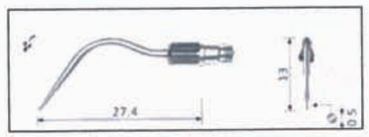

k60A

PUNTA LUNGA DRITTA CON SUPERFICI ARROTONDATE, LA K60A VIENE UTILIZZATA PER UNA PULIZIA DELICATA DELLE TASCHE DURANTE IL TRATTAMENTO PERIODONTALE. E' EFFICACE PER LA PULIZIA NELLE TASCHE FINO AI 9MM DI PROFONDITA'. UTILIZZATA NELLE REGIONI ANTERIORI, SUPERFICI LISCE.

PULIZIA IMPIANTO

kICPA SET

PULIZIA IMPIANTI. SET COMPOSTO DA: **CHIAVE, INSERTO E DUE PEEK**
INSERTO PEEK PER UNA SICURA E GENTILE PULIZIA DEGLI IMPIANTI E RESTAURI.

PULIZIA IMPIANTO

ICPpeek

RICAMBIO. PEEK CONFEZIONE DA 10

Medical Way

INSERTI

COMPATIBILITA' **KAVO**

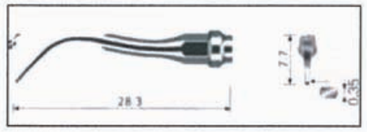

k#9 **(GC2)**

UTILIZZATA PER RIMUOVERE IL TARTARO E LA PLACCA BATTERICA SOPRA-GENGIVALE E INTERDENTALE.

PIEZOLUX & SONOSOFT

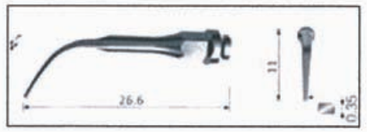

k#10 **(GC1)**

UTILIZZATA PER RIMUOVERE IL TARTARO E LA PLACCA BATTERICA SOPRA-GENGIVALE E INTERDENTALE.

PIEZOLUX & SONOSOFT

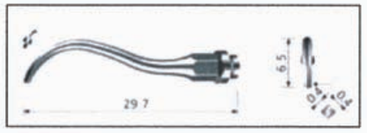

k#11

UTILIZZATA PER RIMUOVERE IL TARTARO SUB-GENGIVALE

PIEZOLUX & SONOSOFT

INSERTI

COMPATIBILITA' **KAVO**

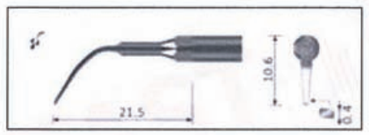

k201

UNIVERSALE. ACCURATA RIMOZIONE DEL TARTARO COMPATTO SOPRA-GENGIVALE IN TUTTI I QUADRANTI

PIEZOLED

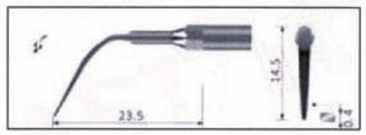

k202

PERIO. LO STRUMENTO P E' ADATTO PER LA RIMOZIONE PRECISA DEL TARTARO SUB-GENGIVALE, SOPRA-GENGIVALE E CONCREZIONI IN TUTTI I QUADRANTI

PIEZOLED

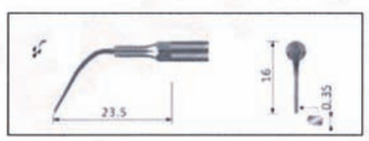

k203

PERIOSLIM. VELOCE E POCO INVASIVO LO STRUMENTO PS E IDEALE PER LA RIMOZIONE DEL TARTARO NELLE TASCHE PERIODONTALI PROFONDE IN TUTTI I QUADRANTI

PIEZOLED

INSERTI

COMPATIBILITA' **MECTRON**

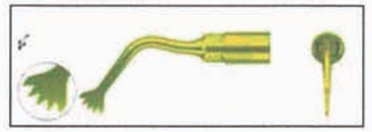

US1

SEGA OSSO. OSTEOTOMIA DI GRANDI SEZIONI OSSEE DURANTE LA CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE.

TAGLIO DELL'OSSO

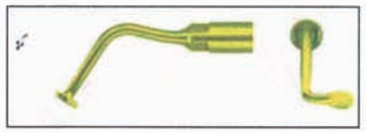

US1L

MICRO-SEGA ANGOLARE 0.6MM.
TUTTE LE TECNICHE DI OSTEOTOMIA NELLA MASCELLA E NELLA MANDIBOLA; INNESTO DI BLOCCO OSSEO, OSTEOTOMIA ORIZZONTALE-ANGOLO SINISTRO

TAGLIO DELL'OSSO

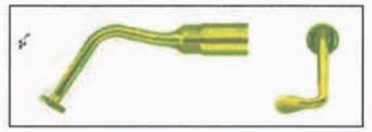

US1R

MICRO-SEGA ANGOLARE 0.6MM.
TUTTE LE TECNICHE DI OSTEOTOMIA NELLA MASCELLA E NELLA MANDIBOLA; INNESTO DI BLOCCO OSSEO, OSTEOTOMIA ORIZZONTALE-ANGOLO DESTRO

TAGLIO DELL'OSSO

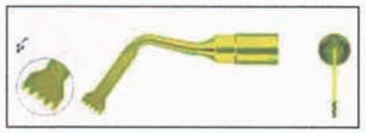

US2

SEGA DI PRECISIONE. UTILIZZATA PER TAGLIARE L'OSSO, CON GRANDE PRECISIONE ED EFFICIENZA. CINQUE DENTI AFFILATI.

TAGLIO DELL'OSSO

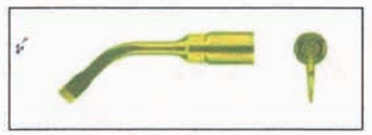

US3

SCALPELLO BASE. OSTEOTOMO DI GRANDE PRECISIONE IN STRUTTURE ATOMICAMENTE SOTTILI (PER ESEMPIO ESPANSIONE DELLA CRESTA, CORTICOTOMIE INTERDENTALI)

TAGLIO DELL'OSSO

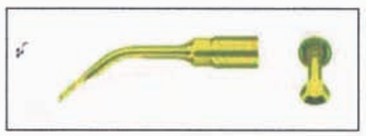

US4

SCALPELLO/BISTURI OSTEOPLASTICO. OSTEOPLASTICA UNIVERSALE, OSTEOTOMIA PERIODONTALE, ALLUNGAMENTO DELLA CORONA, RACCOLTA DI FRAMMENTI OSSEI, RIMOZIONE DEI TESSUTI INFIAMMATORI (CISTLECC.)

TAGLIO DELL'OSSO

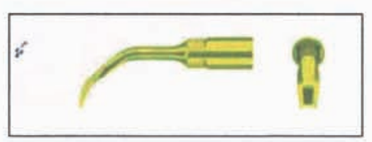

US5

RASCHIETTO. RIMODELLAMENTO OSSEO E RACCOLTA DI FRAMMENTI OSSEI.

TAGLIO DELL'OSSO

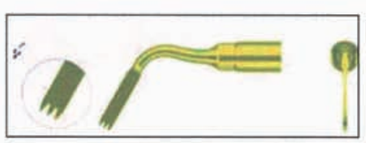

US6

SPECIALE MICRO-SEGA (3 DENTI).
TECNICA DI OSTEOTOMIA E CORTICOTOMIA MOLTO SOTTILE E PICCOLA PER MICROCHIRURGIA ORTODONTICA, TECNICA DELLA FRAZIONE DELLA RADICE PER MANOVRA DI ESTRAZIONE DENTALE.

TAGLIO DELL'OSSO

INSERTI

COMPATIBILITA' MECTRON

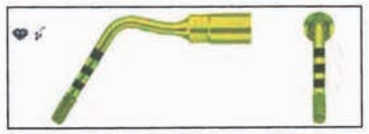

OT4

PREPARAZIONE SITO IMPLANTARE.
CORREZIONE DELL'ASSE DELL'OSTEOTOMIA PILOTA, PER FINALIZZARE LA PREPARAZIONE DEL SITO IMPLANTARE VICINO AL NERVO ALVEOLARE; TECNICHE DI APPROCCIO SINUSALE CRESTATE.

TAGLIO DELL'OSSO

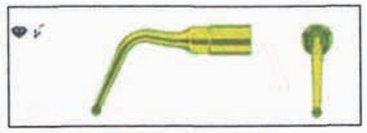

OT5

OSTEOTOMIA E OSTEOPLASTICA.
OSTEOTOMIA DI GRANDE PRECISIONE IN SPAZI ANATOMICAMENTE STRETTI (PER ESEMPIO ESPANSIONE DELLA CRESTA, CORTICOTOMIA INTERDENTALE)

TAGLIO DELL'OSSO

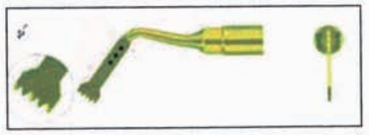

OT7

MICRO-SEGA PRINCIPALE 0.5MM
TECNICHE DI OSTEOTOMIA NELLA MASCELLA E NELLA MANDIBOLA, ESPANSIONE DELLA CRESTA, TECNICHE DI CORTICOTOMIA, INNESTO OSSEO.

TAGLIO DELL'OSSO

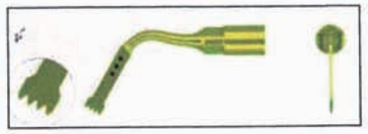

OT7S-4

MICRO-SEGA SPECIALE 0.35 (4 DENTO
OSTEOTOMIA MOLTO SOTTILE, TECNICHE DI MICRO CHIRURGIA ORTODONTICA, SEPARAZIONE DELLE RADICI NELLE TECNICHE DI ESTRAZIONE E CHIRURGIA PERIODONTALE

TAGLIO DELL'OSSO

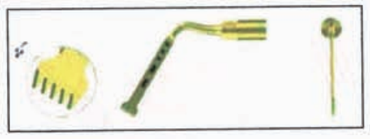

OT7-20

OSTEOTOMIA ESPANSIONE DELLA CRESTA, INNESTO OSSEO (DAL MENTO, MANDIBOLA) TECNICHE DI OSTEOTOMIA LEFORT, OSTEOTOMIA BILATERALE SAGGITALE.

TAGLIO DELL'OSSO

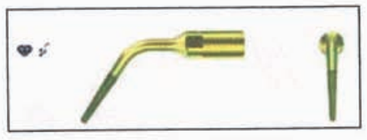

OP6

PREPARAZIONE MICRO-RADICALE UTILIZZATA PER LA PREPARAZIONE DELLE RADICI NELLA CHIRURGIA PERIODONTALE

TAGLIO DELL'OSSO

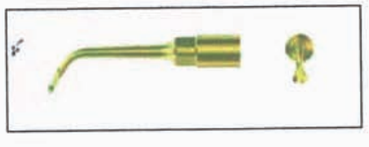

OP7

MICRO-OSTEOPLASTICA UTILIZZATA PER L'ACCESSO ALL'OSSO MASCELLARE PER OSTEOTOMIA PERI-APICALE, RIMOZIONE DEI TESSUTI INFIAMMATORI

TAGLIO DELL'OSSO

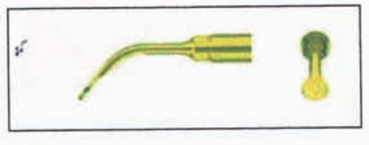

UL1

SEPARATORE MEMBRANA SINUSALE ANGOLATO A 130°.
NON TAGLIENTE SEPARATORE DELLA MEMBRANA SINUSALE

SOLLEVAMENTO SINUSALE

INSERTI

COMPATIBILITA' MECTRON

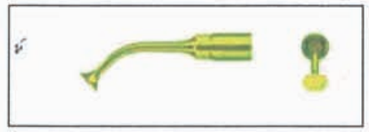

UL2

SEPARATORE MEMBRANA SINUSALE SEPARATORE DELLA MEMBRANA SINUSALE, 2MM INTORNO AL TELAIO DELLA FINESTRA OSSEA.

SOLLEVAMENTO SINUSALE

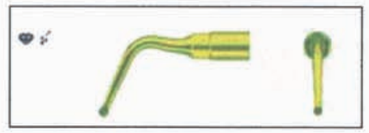

UL3

TAGLIA OSSA SENSIBILE UTILIZZATO PER IL TAGLIO DELL'OSSO VICINO AI TESSUTI O ALLE REGIONI SENSIBILI CON IL MINOR TRAUMA. RIVESTIMENTO DIAMANTATO SU PALLA E INSERTO

SOLLEVAMENTO SINUSALE

UL4

OSTEOTOMIA FINESTRA OSSEA SINUSALE OSTEOTOMIA PERIODONTALE, ALLUNGAMENTO DELLA CORONA, RACCOLTA FRAMMENTI OSSEI, RIMOZIONI TESSUTI INFIAMMATORI (CISTI, ECC.)

SOLLEVAMENTO SINUSALE

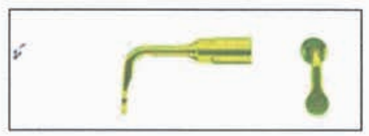

UL5

SEPARATORE ANGOLATO A 105° MEMBRANA SINUSALE SEPARATORE NON TAGLIENTE DELLA MEMBRANA SINUSALE

SOLLEVAMENTO SINUSALE

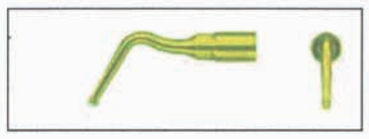

UI1

1.6MM ALLARGAMENTO UTILIZZATA PER ALLARGARE L'AREA D'IMPIANTO EVITANDO TRAUMI AI TESSUTI MOLLI

IMPLANTOLOGIA

UI2

2.0MM ALLARGAMENTO UTILIZZATA PER ALLARGARE L'AREA D'IMPIANTO EVITANDO TRAUMI AI TESSUTI MOLLI

IMPLANTOLOGIA

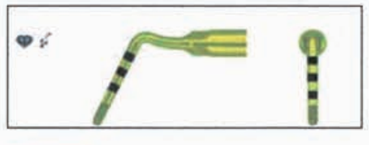

UI7

PREPARAZIONE UTILIZZATA PER LA PREPARAZIONE FINALE DELL'OSSO NELL'AREA D'IMPIANTO

IMPLANTOLOGIA

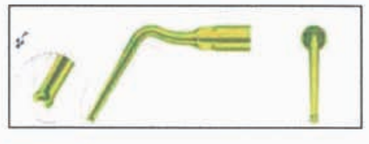

UI8

PREPARAZIONE PER L'IMPIANTO, LARGHEZZA MASSIMA 1.6MM

IMPLANTOLOGIA

Medical Way

INSERTI

COMPATIBILITA' MECTRON

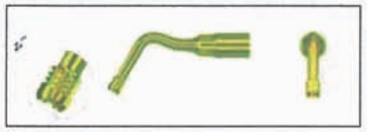

IMPLANTOLOGIA

UI9

PREARAZIONE IMPIANTO 2.8MM TESTA DA TAGLIO

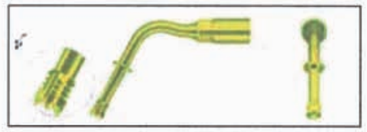

IMPLANTOLOGIA

UI9B

PREPARAZIONE PROFONDA 2.8MM TESTA DA TAGLIO

IMPLANTOLOGIA

IM2A

PERFORAZIONE DELL'OSSO OSTEOTOMIA PILOTA NELLA REGIONE ANTERIORE (NELLA MASCELLA)

IMPLANTOLOGIA

IM2P

PERFORAZIONE DELL'OSSO OSTEOTOMIA PILOTA NELLA REGIONE POSTERIORE (NELLA MASCELLA)

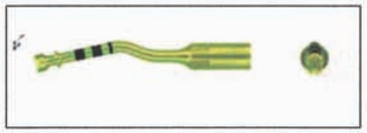

IMPLANTOLOGIA

IM3A

PERFORAZIONE DELL'OSSO ALLARGA O FINALIZZA L'AREA D'IMPIANTO, INSERTO CON DOPPIA IRRIGAZIONE PER EVITARE IL SURRISCALDAMENTO (NELLA MASCELLA).

IMPLANTOLOGIA

IM3P

PERFORAZIONE DELL'OSSO ALLARGA O FINALIZZA L'AREA D'IMPIANTO, INSERTO CON DOPPIA IRRIGAZIONE PER EVITARE IL SURRISCALDAMENTO (NELLA MASCELLA)

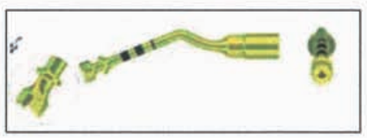

IMPLANTOLOGIA

IM4A

PERFORAZIONE DELL'OSSO FINALIZZA L'AREA D'IMPIANTO, INSERTO CON DOPPIA IRRIGAZIONE PER EVITARE IL SURRISCALDAMENTO (NELLA MASCELLA)

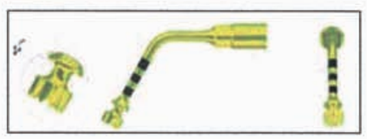

IMPLANTOLOGIA

IM4P

PERFORAZIONE DELL'OSSO FINALIZZA L'AREA D'IMPIANTO, INSERTO CON DOPPIA IRRIGAZIONE PER EVITARE IL SURRISCALDAMENTO

INSERTI

COMPATIBILITA' MECTRON

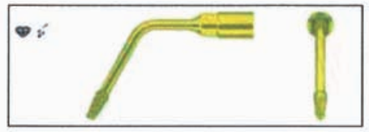

IMPLANTOLOGIA

IP2-3

PREAPARZIONE PILOTA SITO D'IMPIANTO OTTIMIZZA LA CONCENTRICITÀ DELL'AREA D'IMPIANTO TRA 2 E 3MM

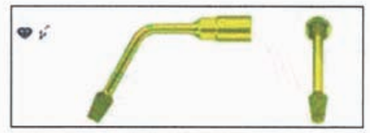

IMPLANTOLOGIA

IP3-4

OSTEOTOMIA MICROMETRICA OTTIMIZZA LA CONCENTRICITÀ DELL'AREA D'IMPIANTO TRA 3 E 4MM

INSERTI

COMPATIBILITA' MECTRON

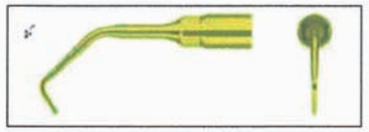

ENDO

UE1

PULIZIA PROFONDA DEL CANALE RIMOZIONE DEL TESSUTO DEVITALIZZATO NELLA RADICE APICALE.

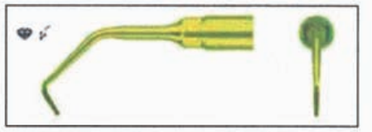

ENDO

UE2

PULIZIA DELICATA DEL CANALE RIMOZIONE DELICATA DEL TESSUTO DEVITALIZZATO NELLA RADICE APICALE

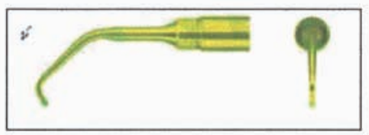

ENDO

UE3

PULIZIA PROFONDA DEL CANALE RIMOZIONE DEL TESSUTO DEVITALIZZATO NELLA RADICE APICALE

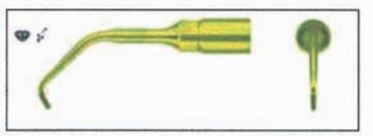

ENDO

UE4

PULIZIA DELICATA DEL CANALE RIMOZIONE DELICATA DEL TESSUTO DEVITALIZZATO NELLA RADICE APICALE

INSERTI

COMPATIBILITA' MECTRON

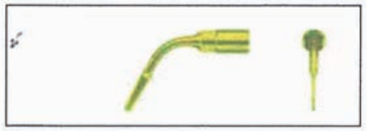

ESTRAZIONE

EX1

SCALPELLO D'ESTRAZIONE OSTEOPLASTICA DELLE RADICI TAGLIO DELLE ANCHILOSI, TECNICA DI FRAZIONE RADICALE

ESTRAZIONE

EX2

SCALPELLO D'ESTRAZIONE ANGOLATO OSTEOPLASTICA DELLE RADICI NELLE REGIONI POSTERIORI

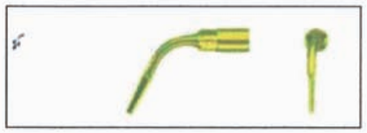

ESTRAZIONE

EX3

MICRO-SEGA ANGOLATA 0.6MM OSTEOPLASTICA DELLE RADICI NELLE REGIONI POSTERIORI

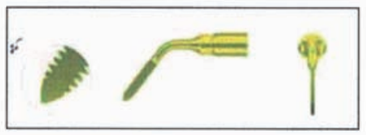

ESTRAZIONE

XM-NINJA

SEZIONE DEL DENTE INSERTO SEGA-DENTE PARTICOLARMENTE EFFICIENTE PER LE EMISEZIONI E LE AMPUTAZIONI DELLE RADICI

ESTRAZIONE

UC1

SCALPELLO D'ESTRAZIONE OSTEOPLASTICA DELLE RADICI TAGLIO DELLE ANCHILOSI, TECNICA DI FRAZIONAMENTO DELLE RADICI

INSERTI

COMPATIBILITA' MECTRON

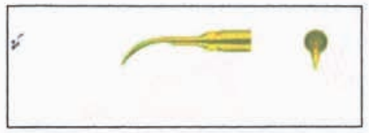

ABLAZIONE

UP1

ABLAZIONE DELICATA ABLAZIONE DELLE RADICI

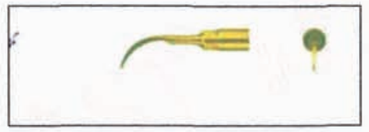

ABLAZIONE

UP2

ABLAZIONE PERIODONTALE ABLAZIONE E RIMOZIONE DEI TESSUTI INFIAMMATORI ESTRAZIONE DELL'APICE DELLA RADICE FRATTURATA

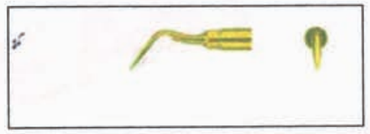

ABLAZIONE

UP3

CURETTE ANGOLATO CURETTE ANGOLATA ABLAZIONE DELLE RADICI

ABLAZIONE

UP4

ABLAZIONE E MICRODEBRIDEMENT RIMOZIONE DEI TESSUTI DEVITALIZZATI E PIALLATURA DELLA RADICE DURANTE LA CHIRURGIA PERIODONTALE RESETTIVA E RIGENERATIVA

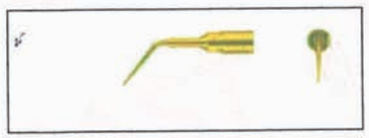

ABLAZIONE

UP5

MICRO-LISCIAMENTO SUPERFICI DELLE RADICI PIALLATURA DELLE RADICI

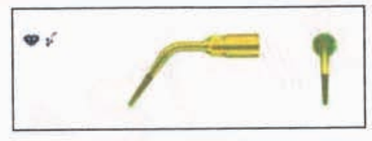

ABLAZIONE

UP6

PREPARAZIONE MICRO-RADICALE PREPARAZIONE DELLE RADICI NELLA CHIRURGIA PERIODONTALE

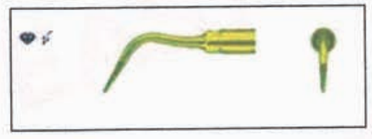

ABLAZIONE

UP7

MICRO-OSTEOPLASTICA OSTEOPLASTICA INTERPROSSIMALE E PIALLATURA DELLE RADICI

INSERTI

COMPATIBILITA' **EMS**

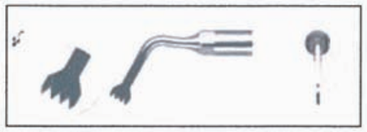

CHIRURGIA OSSEA

E-BS1

SEGA PER CORTECCIA OSSEA LA SEGA VIENE UTILIZZATA NELLA CHIRURGIA ORTODONTICA PER TAGLIARE LA CORTECCIA OSSEA.
CHIRURGIA PRE-IMPLANTARE.

CHIRURGIA OSSEA

E-BS2L

SEGA PER CORTECCIA OSSEA SINISTRA SEGA PER LA CORTECCIA OSSEA ORIENTATA A SINISTRA

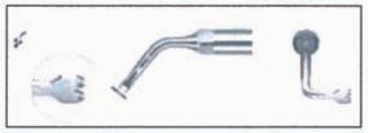

CHIRURGIA OSSEA

E-BS2R

SEGA PER CORTECCIA OSSEA DESTRA SEGA PER LA CORTECCIA OSSEA ORIENTATA A DESTRA

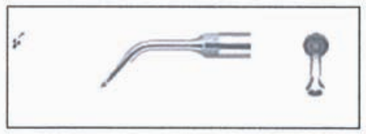

CHIRURGIA OSSEA

E-BS4

SCALPELLO CIRCOLARE SCALPELLO CIRCOLARE A 130° PER L'OSTEOPLASTICA E LA RACCOLTA DI PARTICELLE O FRAMMENTI OSSEI.

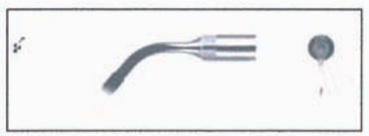

CHIRURGIA OSSEA

E-BS5

SCALPELLO PIATTO SCALPELLO PIATTO PER OSTEOTOMIA FINE, PREPARAZIONE DEL LEMBO OSSEO

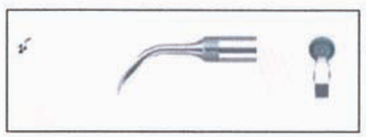

CHIRURGIA OSSEA

E-BS6

SCALPELLO RICURVO EFFICACE PER IL RIMODELLAMENTO OSSEO. UTILIZZATO PER ESEGUIRE OSTEOPLASTICHE E RIMODELLAMENTI DELL'OSSO CHE NON ASSICURA IL SUPPORTO OSSEO. PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER SEGNARE UN PUNTO DI RIFERIMENTO PROTESICO DEL DENTE DOVE INIZIERÀ L'OSTEOPLASTICA.

INSERTI

COMPATIBILITA' **EMS**

SOLLEVAMENTO SINUSALE

E-SL1

OSTEOTOMIA FINESTRA OSSEA SINUSALE. RIVESTIMENTO DIAMANTATO, INSERTO PER IL TAGLIO DELLA FINESTRA OSSEA VESTIBOLARE E ATTENUAZIONE DEGLI ANGOLI TAGLIENTI.

SOLLEVAMENTO SINUSALE

E-SL3

SEPARTORE MEMBRANA SINUSALE INSERTO NON TAGLIENTE UTILIZZATO PER SOLLEVARE LA MEMBRANA SCHNEIDERIAN SUI BORDI DELLA FINESTRA

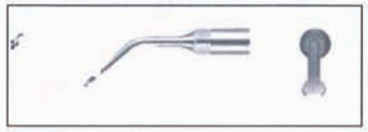

SOLLEVAMENTO SINUSALE

E-SL5

SPATOLA NON TAGLIENTE SPATOLA NON TAGLIENTE UTILIZZATA PER SOLLEVARE LA MEMBRANA DI SCHNEIDERIAN ALL'INTERNO DEL SINUSALE E PER IL DISINNESTO DELLE STRUTTURE ANATOMICHE

ESTRAZIONE

E-LC1

OSTEOPLASTICA DELLE RADICI UTILIZZATA PER SINOMOTOMIA E OSTEOTOMIA PERIRADICOLARE

ESTRAZIONE

E-LC2

SCALPELLO SOTTILE INSERTO SOTTILE, PARTICOLARMENTE SOTTILE. UTILIZZATA PER L'ACCESSO AGLI SPAZZI STRETTI TRA LA RADICE E L' OSSO ALVEOLARE

ESTRAZIONE

E-LC2L

SCALPELLO ANGOLARE ORIENTATO A SINISTRA 45° FACILITA L'ACCESSO ALLE AREE POSTERIORI.

ESTRAZIONE

E-LC2R

SCALPELLO ANGOLARE ORIENTATO A DESTRA 45° FACILITA L'ACCESSO ALLE AREE POSTERIORI.

ESTRAZIONE

E-PIRAHNA

AMPUTATORE DI RADICE INSERTO SEGA-DENTA PARTICOLARMENTE EFFICACE PER EMISEZIONI, AMPUTAZIONE DELLE RADICI.

INSERTI

Piezotome® 1 **Piezotome® 2**

COMPATIBILITA' **SATELEC**

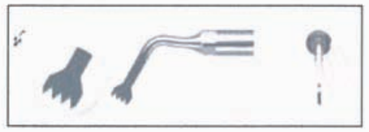

CHIRURGIA OSSEA

BS1 **V-BS1**

SEGA PER CORTECCIA OSSEA LA SEGA VIENE UTILIZZATA NELLA CHIRURGIA ORTODONTICA PER TAGLIARE LA CORTECCIA OSSEA.
CHIRURGIA PRE-IMPLANTARE.

CHIRURGIA OSSEA

BS2L **V-BS2L**

SEGA PER CORTECCIA OSSEA SINISTRA SEGA PER LA CORTECCIA OSSEA ORIENTATA A SINISTRA

CHIRURGIA OSSEA

BS2R **V-BS2R**

SEGA PER CORTECCIA OSSEA DESTRA SEGA PER LA CORTECCIA OSSEA ORIENTATA A DESTRA

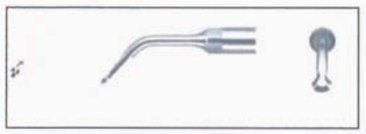

CHIRURGIA OSSEA

BS4 **V-BS4**

SCALPELLO CIRCOLARE. SCALPELLO CIRCOLARE A 130° PER OSTEOPLASTICA E RACCOLTA DI PARTICELLE E FRAMMENTI OSSEI

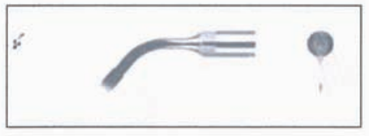

CHIRURGIA OSSEA

BS5 **V-BS5**

SCALPELLO PIATTO SCALPELLO PIATTO PER OSTEOTOMIA FINE E PREPARAZIONE OSSEA

SOLLEVAMENTO SINUSALE

SL2 **V-SL2**

OSTEPLASTICA MICROMETRICA RIVESTIMENTO DIAMANTATO DELL'INSERTO E DELLA PALLA PER LEVIGARE LA FINESTRA OSSEA VESTIBOLARE E OSTEOPLASTICA PRECISA

INSERTI

Piezotome® 1 **Piezotome® 2**

COMPATIBILITA' **SATELEC**

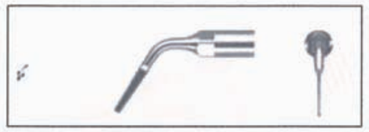

ESTRAZIONE

LC1 **V-LC1**

OSTEOPLASTICA DELLE RADICI UTILIZZATA PER SINOMOTOMIA E OSTEOTOMIA PERIRADICOLARE

ESTRAZIONE

LC1/90 **V-LC1/90**

SCALPELLO D'ESTRAZIONE UTILIZZATO PER TAGLIARE I LEGAMENTI CON IL MINOR TRAUMA QUANDO SI ESTRAGGONO I DENTI SOLIDI

ESTRAZIONE

LC2 **V-LC2**

SCALPELLO SOTTILE INSERTO SOTTILE, PARTICOLARMENTE SOTTILE, UTILIZZATO PER L'ACCESSO AGLI SPAZZI STRETTI TRA LA RADICE E L' OSSO ALVEOLARE

ESTRAZIONE

LC2L **V-LC2L**

SCALPELLO ANGOLATO ORIENTATO A SINISTRA A 45° FACILITA L'ACCESSO ALLE AREE POSTERIORI

ESTRAZIONE

LC2R **V-LC2R**

SCALPELLO ANGOLATO ORIENTATO A DESTRA A 45° FACILITA L'ACCESSO ALLE AREE POSTERIORI

ESTRAZIONE

PIRAHNA **V-PIRAHNA**

AMPUTATRORE DI RADICI INSERTO SEGA-DENTE PARTICOLARMENTE ADATTO PER EMISEZIONI E AMPUTAZIONE DELLE RADICI.

LINEAR TIP MOVEMENT



SYNTHETIC MATERIAL HOUSING

STAINLESS STEEL CAP

STERILISABLE AND THERMODISINFECTABLE

LIGHT: √ **SCALER TIP TYPES**[1]**:** EMS, SATELEC, **HOSE CONNECTION TYPES:** EN-060A, EN061A, EN041, F12 609, F12 281, 1.007.3005 **COVER:** STEEL **6-LED LIGHT RING:** √ **FREQUENCY RANGE (KHZ):** 24 - 33 **WEIGHT (G):** 50 **WARRANTY (MONTHS):** 12

SABBIATRICI

S-11

MADE PRC

• AD ACQUA • **COMPATIBILE CON ATTACCO MIDWEST**

AP10

MADE PRC

• **COMPATIBILE CON ATTACCO KAVO & MIDWEST**

LAMPADE POLIMERIZZATRICI

SOLAR 2200

MADE PRC

• RICARICABILE • INTENSITÀ LUMINOSA COSTANTE• INTENSITÀ DELLA LUCE REGOLABILE
• BATTERIA AGLI IONI DI LITIO AD ALTA CAPACITÀ • MANICO IN METALLO • POTENZA: 2200MW/CM²

MICROMOTORI

SUPER

MADE IN S. COREA

• POTENZA ASSORBITA: 50 WATT, • VELOCITÀ: MAX 50.000 RPM
• ALIMENTAZIONE: 230V - HZ 50/60,
• DIMENSIONI CENTRALINA (L X P X H MM): 100 X 200 X 200,
• PESO MANIPOLO: 358GR
• DIAMETRO MANIPOLO: 25MM
• LUNGHEZZA MANIPOLO: 162MM
• PESO TOTALE: 2,5 KG
• PINZA: Ø 2,35 MM
• AD INDUZIONE

SONG YOUNG

MADE IN TAIWAN

• POTENZA ASSORBITA: 150W
• VELOCITÀ MAX 50.000 RPM
• ALIMENTAZIONE 230V
• DIMENSIONE CENTRALINA 262X165X83 MM
• PESO MANIPOLO 353GR
• DIAMETRO MANIPOLO 275MM
• LUNGHEZZA MANIPOLO 150MM
• PESO TOTALE 2.3KG
• PINZA 2.35MM
• AD INDUZIONE

FUZHOU ON/OFF

MADE PRC

• ALIMENTAZIONE 220V
• PINZA 2.35MM
• MAX 35.000 RPM
• A CARBONCINI
• PEDALE ON/OFF

MINI CAPPA

BOX

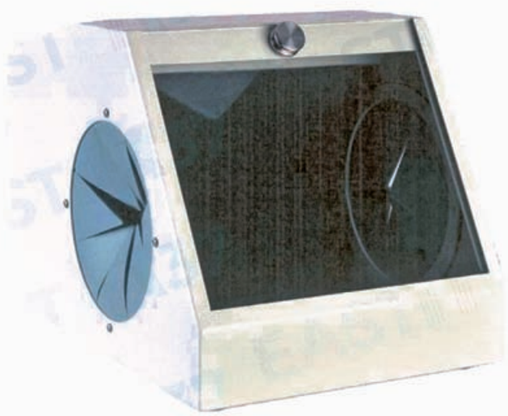

MADE PRC

• LUCE A LED • DUE VENTOLE DI ASPIRAZIONE. • FILTRO PER LA POLVERE • STRUTTURA IN METALLO • VETRO ANTERIORE ESTRAIBILE PER LA PULIZIA
• DIMENSIONE: 30X21X26 • PESO: 4 KG

VASCA ULTRASUONI

GT SONIC-S6

MADE PRC

• VOLUME: 6 LITRI
• POTENZA ULTRASONICA: 150W
• POTENZA DI RISCALDAMENTO: 300W
• FREQUENZA: 40KHZ
• RISCALDAMENTO: [COJ: 30-80
• CONTROLLO DEL TEMPO: 1-99 MINUTI
• DIMENSIONI SERBATOIO: 300X155X150
• VALVOLA DI DRENAGGIO
• ACCESSORI STANDARD: CESTO, COPERCHIO E CAVO DI ALIMENTAZIONE
• PIASTRA IN ACCIAIO INOSSIDABILE SPECCHIO NERO DI TITANIO [NESSUNA IMPRONTA, FACILE DA PULIRE, RESISTENTE AL GRAFFIJ
• PANNELLO TOUCH

NOTE

MATERIALI DA OTTURAZIONE

L'azienda **Mega-Physik** è stata fondata nel 1970 a Rastatt, nella regione del Baden-Württemberg.

Da allora **Mega-Physik** è sinonimo di ricerca e innovazione nell'ambito della produzione di lampade fotopolimerizzatrici utilizzate in odontoiatria in tutto il mondo.

La **Mega-Physik** è una società privata a conduzione familiare. Tutti i nostri collaboratori hanno sempre piacere a seguire i nostri clienti con una consulenza competente e cordiale.

Un secondo stabilimento per materiali dentali è stato inaugurato nel 1999 in Radeberg, in Sassonia. La **Mega-Physik** distribuisce i suoi prodotti in tutto il mondo tramite partner commerciali. I materiali dentali della **Mega-Physik** vengono utilizzati con successo da dentisti in più di 50 paesi.

La certificazione del sistema di controllo della qualità EN ISO 9001:2008 e DIN EN ISO 13485:2003, in conformità con le norme per la realizzazione di presidi medico-chirurgici, conferma l'eccezionale livello di qualità dei prodotti **Mega-Physik**.

SWISS TS

CERTIFICATE

Mega-Physik Gesellschaft für physikalische Messtechnik GmbH &Co. KG
D-76437 Rastatt

Development, manufacture and distribution of light polymerization equipments, dental materials and composite systems

ISO 9001:2008 Quality management
ISO 13485:2003 for medical devices

TÜV NORD

EG-Zertifikat / EC-Certificate

MEGA-PHYSIK
Gesellschaft für physikalische Messtechnik mbH

Dentalwerkstoffe und Kompositsysteme
Dental materials and Composite systems

MATERIALI DA OTTURAZIONE

HYBRISUN ceram

HYBRISUN ceram è un composito microibrido universale fotoindurente di concezione unica per ricostruzioni dei denti anteriori e laterali. Grazie a una speciale struttura con particolari fibre di vetro, basata sulle esperienze nel campo delle nanotecnologie, è possibile ottenere una percentuale superiore di riempitivi rispetto a quella di HYBRISUN classic. Con HYBRISUN ceram si mantengono allo stesso tempo le usuali caratteristiche di lavorazione ottenendo, grazie a questa innovativa combinazione di riempitivi in ceramica, un'elevata stabilità dimensionale e una contrazione ridotta. Hybrisun ceram presenta un marcato effetto camaleonte e un'opalescenza naturale. Grazie a un'ampia gamma di colori e alla sua lucidabilità ad elevata brillantezza, HYBRISUN ceram si rivela straordinariamente adatto alla tecnologia di stratificazione e alla terapia estetica di otturazione.

Confezioni singole:	siringa a pistone rotante da 4 g Minifill 10x250 mg; 20x250 mg

Confezioni in assortimento:

Kit	(3 siringhe)	A2 / A3 / A3,5 / C-BOND ceram 5 ml / C-CID 3 g / accessori
Kit	(4 siringhe)	A1 / A2 / A3 / A3,5 / C-BOND ceram 5 ml / C-CID 3 g / accessori
Kit	(6 siringhe)	A1 / A2 / A3 / A3,5 / B2 / D3 / C-BOND ceram 5 ml / C-CID 3 g / accessori
		(Assortimento di colori personalizzato a richiesta)

Colori per lo smalto:	A1 / A2 / A3 / A3,5 / A4 / B1 / B2 / B3 / B4 / C1 / C2 / C3 / C4 / D2 / D3 / D4 / Incisale bianco-grigio
Colori della dentina:	A1 / A2 / A3 / A3,5 / B2 / D3

MATERIALI DA OTTURAZIONE

HYBRISUN ceram *flow*

HYBRISUN ceram *flow* è un materiale da otturazione, fluido, universale.

HYBRISUN ceram *flow* presenta una fluorescenza naturale e si utilizza nella terapia di otturazione delle micropreparazioni e difetti dei colletti, nella sigillatura estesa di solchi, nel fissaggio e nella riparazione di compositi e nelle ricostruzioni in ceramica, nonché per l'applicazione del primo strato di otturazione del dente nelle ricostruzioni in composito.

Grazie a una leggera consistenza tissotropica, HYBRISUN ceram *flow* non sgocciola, è molto stabile e può essere applicato direttamente nei punti desiderati. La matrice rinforzata con riempitivi in ceramica di HYBRISUN ceram *flow* garantisce una contrazione da polimerizzazione ridotta come anche un'elevata resistenza all'abrasione a otturazione terminata.

Un'equilibrata trasparenza e la possibilità di combinazione con materiali da otturazione, ad es. HYBRISUN ceram e C-Bond ceram permettono un campo di applicazione ottimale per HYBRISUN ceram *flow*.

HYBRISUN ceram *flow* è disponibile nei principali colori di base di uso comune.

Confezioni singole: siringa da 2 g

Confezioni in assortimento:
Kit (4 siringhe) A1 / A2 / A3 / A3,5 / C-BOND ceram 5 ml / C-CID 3 g / accessori
(Assortimento di colori personalizzato a richiesta)

Colori per lo smalto: A1 / A2 / A3 / A3,5 / B2 / B3
Colori della dentina: A2 / A3

MATERIALI DA OTTURAZIONE

HYBRISUN nano *flow*

HYBRISUN nano *flow* è un materiale da otturazione fluido di nuova concezione e riunisce le proprietà tipiche di un composito fluido con le più recenti scoperte della nanotecnologia.

La percentuale di riempitivi totali di HYBRISUN nano flow ha un valore superiore al 74 % in peso, molto superiore rispetto a quella dei compositi universali tradizionali. HYBRISUN nano *flow* bagna leggermente la parete della cavità e scorre in modo corretto al suo interno all'atto dell'applicazione.

HYBRISUN nano *flow* bpresenta una fluorescenza naturale alla luce UV e si utilizza nella terapia di otturazione delle micropreparazioni e difetti dei colletti, nella sigillatura estesa di solchi, nel fissaggio e nella riparazione di compositi e nelle ricostruzioni in ceramica, e per l'applicazione del primo strato di otturazione del dente nelle ricostruzioni in composito. Grazie a una leggera consistenza tissotropica, HYBRISUN nano *flow* non sgocciola e può essere applicato direttamente nei punti desiderati. HYBRISUN nano *flow* è combinabile con altri materiali da otturazione, ad es. HYBRISUN nano e N-Bond.

Grazie alla matrice arricchita di nanoparticelle, si ha una minima contrazione del materiale all'atto della polimerizzazione. La ricostruzione finita con HYBRISUN nano *flow* è lucidabile ad alta brillantezza e resistente all'abrasione. HYBRISUN nano *flow* è disponibile nei principali colori di base di uso comune.

Confezioni singole: siringa da 2 g

Confezioni in assortimento:
Kit (4 siringhe) A1 / A2 / A3 / A3,5 / N-BOND 5 ml / C-CID 3 g / accessori
(Assortimento di colori personalizzato a richiesta)

Colori per lo smalto: A1 / A2 / A3 / A3,5 / B2 / B3
Colori della dentina: A2 / A3

MATERIALI DA OTTURAZIONE

HYBRISUN-T

HYBRISUN-T rappresenta un materiale provvisorio, fotoindurente per qualsiasi tipo di otturazione temporanea. HYBRISUN-T contiene fluoruro, che viene rilasciato in modo omogeneo e agisce contro le carie secondarie. HYBRISUN-T è semplice e rapido da applicare, subito resistente e facilmente removibile. HYBRISUN-T è adatto per occlusioni provvisorie e per le cavità.

Confezioni singole: siringa a pistone rotante da 4g
Colore standard: Universale

SISTEMI ADESIVI

Per una terapia di otturazione ottimale, MEGA-PHYSIK mette a disposizione sistemi integrati di altissima qualità. Con C-CID è possibile mordenzare lo smalto dentale o eseguire la tecnica „Total Etch". C-BOND e N-BOND, sono adesivi dentali fotoindurenti, e garantiscono un'elevata aderenza meccanica dell'otturazione allo smalto naturale. Con il legante universale C-PRIME-S plus è possibile eseguire il condizionamento di smalto e dentina in un'unica fase di lavoro.

MEGA-PHYSIK offre vari leganti utilizzabili in laboratori odontotecnici. KERASIL, in qualità di silano adesivo, è adatto alla silanizzazione di superfici in ceramica e metallo. C-PRIME-SE permette la mordenzatura, il condizionamento e il collegamento adesivo in un'unica fase di lavoro. C-FLUORINE perfetto per la mordenzatura di superfici di adesione in ceramica, ad es. per faccette estetiche, capsule in ceramica e intarsi.

C-Cid

C-Cid è un gel mordenzante per la terapia di otturazione adesiva, base di gel di glicerina con il 37 % di acido fosforico. C-CID si adatta anche alla tecnica di „Total Etch".

Confezioni singole: siringa da 3 g,
siringa da 5 g

N-Bond

Adesivo dentale con nanotecnologia

N-Bond è un adesivo dentale fotoindurente, rinforzato con nanoparticelle. Grazie all'aggiunta di nanoparticelle, si migliorano le caratteristiche del prodotto senza aumentare la viscosità dell'agglomerato. N-Bond è facile da applicare e bagna completamente la cavità del dente. Grazie alla ridottissima contrazione da polimerizzazione, si riduce al minimo anche la formazione di fenditure sui bordi nella terapia di otturazione. N-BOND si utilizza per la sigillatura di solchi e per il fissaggio adesivo.

Confezione singola: flacone da 5 ml

C-Prime SE

C-Prime SE è un adesivo autocondizionante fotoindurente per componenti singoli, dentina o smalto. Non sono più necessarie le fasi di lavoro di mordenzatura, risciacquo, applicazione del primer e adesione, grazie all'applicazione diretta di C-PRIME SE e alla successiva fotopolimerizzazione.

C-PRIME SE garantisce valori di aderenza elevati allo smalto e alla dentina, assicurando un collegamento di lunga durata e privo di fessure sui bordi tra la sostanza durante del dente e il materiale da otturazione. C-PRIME SE offre, senza primer supplementare, un'aderenza sicura a diversi materiali quali metallo, zircone e ossido di alluminio.

Confezione singola: flacone da 5 ml

CEMENTI

Megafix in polvere / liquido

Megafix è un cemento da otturazione vetroionomerico con polvere e liquido. L'applicazione corrisponde a quella di MEGAFIX Aqua-Set.

Contenuto della confezione:	20 g di polvere, 10 ml di liquido
	Misurino di dosaggio
	Unità di miscelazione

C-CEMENT flow

C-CEMENT è un cemento composito a facile scorrimento, fotoindurente e/o indurente per via chimica. Adatto al fissaggio di ricostruzioni in composito e in ceramica (ad es. intarsi di tipo Inlay e Onlay, corone e ponti). Facile da applicare tramite doppia siringa e miscelazione ad aghi forati. C-CEMENT flow si adatta al fissaggio di ricostruzioni in composito e in ceramico, nonché ad attacchi ortodontici. Identico al colore del dente questo cemento duale garantisce un fissaggio ad alti valori estetici nelle ricostruzioni.

Contenuto della confezione:	Siringa a doppia camera 2x4,0 g
	Aghi di miscelazione

Kerasil

Kerasil è un silano adesivo universale pronto all'uso per la silanizzazione di superfici in ceramica e in metallo, al fine di permettere un legame chimico con strutture organiche quali compositi.

Confezione singola: flacone da 3 ml

RESINE DI MODELLAZIONE

LIMOD-P/L

LIMOD-P/L è una resina di modellazione autoindurente composta da polvere e liquido, adatta per la modellazione di componenti secondari, intarsi e corone, per il fissaggio di punti di saldatura e la produzione di sovrastrutture di perni. LIMOD-P/L può essere lavorata sia con il pennello, in qualità di pasta sottile a gocce, sia in stato malleabile. LIMOD-P/L presenta un'eccellente malleabilità, è lucidabile ad elevata brillantezza e la sua combustione non lascia residui.

Confezione singola:

Polvere	80 g	o	500 g
Liquido	80 ml	o	500 ml

LIMOD-LC / LIMOD-LC *flow*

LIMOD-LC è una resina di modellazione fotoindurente pronta all'uso all'interno di una siringa a pistone rotante. Grazie alla sua consistenza plastica, LIMOD-LC si adatta in modo particolare alla modellazione di anelli di congiunzione, intarsi di tipo Inlay e Onlay, al fissaggio di punti di saldatura, al bloccaggio dei sottoquadri e alla realizzazione di sovrastrutture nucleo per i perni. **LIMOD-LC *flow***, grazie alla sua consistenza leggermente fluida e all'elevata stabilità, si adatta perfettamente alla modellazione di inserti, corone telescopiche e coniche, scheletrati, punti metallici, ma è anche utilizzabile come LIMOD-LC. Sono possibili la lavorazione e l'innesto direttamente nella bocca del paziente. Entrambe le resine di modellazione possono essere indurite con apparecchi fotoindurenti di normale uso comune con un campo di lunghezze d'onda da 320 a 500 nm. La LIMOD-LC indurita può essere combinata con normali cere ortodontiche.

Confezione singola:	LIMOD-LC	Siringa da 3g
	LIMOD-LC flow	Siringa da 3g

Confezione assortita:	1 LIMOD-LC
	3 LIMOD-LC flow

DISINFEZIONE & IGIENE

DISINFEZIONE ARIA, SUPERFICI, CLIMATIZZATORI E AUTOVETTURE

	BACTISINE SPRAY + DRY MATIC **Principio Attivo:** Benzalconio Cloruro	**DISPENSER AUTOMATICO** Led sostituzione Ricarica **IGIENIZZANTE AEROSOL**	Erogatore automatico Programmabile: 15-30-60 gg Sanificazione di: • superfici • locali • tessuti • oggetti • impianti di climatizzazione	**CONFEZIONI** Dispenser singoli **Cod.Art.10AM0100** Ricariche da ml 250 x 12 **Cod.Art.05AM0100**
	BACTICYD SPRAY PMC – Reg.Min.Sal. nr. 19207 **Principio Attivo:** Alchil-Dimetil-Benzil-Ammonio Cloruro O-fenilfenolo	**DISINFETTANTE SPRAY MULTIUSO** Pronto all'uso	**DISINFEZIONE E DEODORAZIONE DI:** • aria e superfici • tessuti, tende, materassi, cuscini • telefoni, cellulari, cuffie, • carrelli, scarpe, cestini • attrezzature palestra • tavolette wc, accessori • impianti di climatizzazione	**CONFEZIONE** ml 500 x 12 **Cod.Art.05GA0335**
	BACTICYD SPRAY PMC – Reg.Min.Sal. nr. 19207 **Principio Attivo:** Alchil-Dimetil-Benzil-Ammonio Cloruro O-fenilfenolo	**DISINFETTANTE SPRAY MULTIUSO** Pronto all'uso Una bomboletta è efficace per un locale di circa 45 m^3	**DISINFEZIONE E DEODORAZIONE DI:** • locali • climatizzatori • interni e climatizzatori di autovetture, automezzi, camper, imbarcazioni	**CONFEZIONE** ml 150 x 12 **Cod.Art.05GA0330**

DISINFETTANTI E DETERGENTI SUPERFICI E ATTREZZATURE

	LH AMBIENTE PMC – Reg.Min.Sal. nr. 18669 **Principio Attivo:** Benzalconio Cloruro	**DISINFETTANTE DETERGENTE** pH 6,5 Concentrato Profumo: Pino Soluzione al 3%	**DISINFEZIONE, LAVAGGIO E DEODORAZIONE DI:** • Superfici dure in genere • Biancheria infetta	**CONFEZIONI** lt 1 x 12 **Cod.Art.02LH0020** lt 5 x 4 **Cod.Art. 02LH0021**
	LH GAMMA PLUS PMC – Reg.Min.Sal. nr. 19430 **Principio Attivo:** Didecil-Dimetil-Ammonio Cloruro + Orto-Fenil-Fenolo	**DISINFETTANTE DETERGENTE DECONTAMINANTE** pH 10 Concentrazione 11,5% Profumo: Agrumi Diluzioni d'uso dal 2,5% al 10%	**DISINFEZIONE, DEODORAZIONE, DECONTAMINAZIONE DI:** • Superfici dure in genere • Servizi igienici • Rifiuti solidi • Biancheria infetta	**CONFEZIONI** lt 1 x 12 **Cod.Art.02LH0010** lt 5 x 4 **Cod.Art. 02LH0011**

STERILIZZAZIONE, DISINFEZIONE, DECONTAMINAZIONE E DETERSIONE DI STRUMENTI E ATTREZZATURE CHIRURGICHE

	PEROXILL 2000 DETERGO Dispositivo Medico CE 0051 **Principio Attivo:** Acido Peracetico + Tensioattivi + Miscela Plurienzimatica	**DECONTAMINANTE DISINFETTANTE AD ALTO LIVELLO** Polvere composta ad azione biocida, detergente e disgregante rapida. Concentrato.	• Decontaminazione e contemporanea detersione di strumentario chirurgico e/o dispositivi medici. **Diluizione d'uso:** 1% (10 g per 1 litro d'acqua) con tempo di contatto 5 minuti. **Utilizzabile anche in vaschette ad ultrasuoni.**	**CONFEZIONE** Barattolo da 1 kg + misurino x 6 **Cod.Art.04AM0010**
	PEROXILL 2000 SPRAY Dispositivo Medico CE 0051 Soluzione acquosa a base di Perossido d'idrogeno ed alcool	**SOLUZIONE DISINFETTANTE SPORICIDA** Pronta all'uso Soluzione spray per dispositivi medici	Indicato per la disinfezione rapida, efficace e persistente nel tempo di: • superfici di dispositivi medici • superfici in genere di reparti ospedalieri • attrezzature medicali • attrezzature odontoiatriche	**CONFEZIONE** ml 750 x 6 **Cod.Art.04LH0017**
	BACTIZYME® 2000 DETERGO Dispositivo Medico CE 0051 **Principio Attivo:** Benzalconio cloruro Alcool isopropilico Miscela Enzimatica	**DETERGENTE DISINCROSTANTE DISINFETTANTE ENZIMATICO** Soluzione concentrata detergente e disinfettante a base di un complesso enzimatico.	**DETERSIONE, DISINCROSTAZIONE E DISINFEZIONE** di strumenti da materiale organico contaminante. Consigliato anche per l'utilizzo in vasche ad ultrasuoni.	**CONFEZIONE** lt 1 x 12 **Cod.Art.04FA0216**
	BACTIZYME SPRAY 2000 Dispositivo Medico CE 0051 **Principio Attivo:** Benzalconio cloruro Alcool isopropilico Miscela Enzimatica	**DETERGENTE DISINCROSTANTE DISINFETTANTE ENZIMATICO** Pronto all'uso. Detergente e disinfettante a base di un complesso enzimatico.	**DETERSIONE, DISINCROSTAZIONE E DISINFEZIONE** rapida ed efficace su dispositivi medici, strumenti chirurgici, attrezzature ospedaliere ed ambulatoriali.	**CONFEZIONE** ml 750x12 **Cod.Art.04LH0040**

STERILIZZAZIONE, DISINFEZIONE, DECONTAMINAZIONE E DETERSIONE DI STRUMENTI E ATTREZZATURE CHIRURGICHE

BACTISINE® PLUS 2000 Dispositivo Medico CE 0051 **Principi Attivi:** Cloxeridina e Centrimide	**DECONTAMINANTE DETERGENTE** Soluzione concentrata a schiuma frenata. Decontaminazione, detersione, e conservazione asettica di strumenti chirurgici.	**Per termodisinfettori, macchine lavastrumenti e in vaschette e macchine ad ultrasuoni con ciclo a freddo o a caldo. Diluizioni:** • 2% (20ml) per 1l d'acqua: decontaminazione e detersione di dispositivi medico-chirurgici. • 4% (40ml) per 1l d'acqua: Superfici attrezzature nelle aree operatorie	**CONFEZIONE** lt 1 x 12 **Cod.Art.04AM0022**
BACTILEMON SOFT® 2000 Dispositivo Medico CE 0051 **Principi Attivi:** Didecildimetilammonio + Clorexidina	**DISINFETTANTE DETERGENTE** Soluzione acquosa da nebulizzare. Alto potere disinfettante e detergente. Profumazione: Limone. Pronto all'uso. Formulazione priva di Sostanze CMR e Alcool.	Disinfezione e detersione di tutte le superfici, anche verticali e di tutti i dispositivi medici ed odontoiatrici. Pulito ed asciutto. Non opacizza le superfici delicate, quali plastiche, plexiglas e skai delle poltrone odontoiatriche e podologiche.	**CONFEZIONE** lt 1 x 12 + 2 nebulizzatori **Cod.Art.04AM0018**
BACTISAN SPRAY® 2000 Dispositivo Medico CE 0051 **Principi Attivi:** Alchildimetilbenzilammonio cloruro, Didecildimetilammonio cloruro, Clorexidina digluconato, Alcool Etilico ed Isopropilico	**DISINFETTANTE** Soluzione idroalcolica al 62,5%. Profumazione: menta. Pronto all'uso.	Disinfezione di superfici vaste e difficilmente accessibili, piccolo strumentario chirurgico, turbine, attrezzi e riuniti odontoiatrici. • Rapidità di azione • Capacità d'agire anche in presenza di materiale organico • Effetto persistente e cumulativo	**CONFEZIONI** lt 1 x 12 + 2 nebulizzatori **Cod.Art.04FA0213**
BACTISAN FOAM 2000 Dispositivo Medico CE 0051 **Principi Attivo:** Didecildimetilammonio + Clorexidina	**DISINFETTANTE DETERGENTE** Soluzione acquosa sotto forma di schiuma ad alto potere disinfettante e detergente. Profumazione: neutra. Pronto all'uso.	Disinfezione e detersione di tutte le superfici, anche verticali e di tutti i dispositivi medici ed odontoiatrici. Formulazione priva di: • Sostanze CMR • Alcool • Profumi e altri ingredienti con carattere irritante e/o sensibilizzante	**CONFEZIONE** lt 1 x 12 + 4 foamer **Cod.Art.04AM0017**

STERILIZZAZIONE, DISINFEZIONE, DECONTAMINAZIONE E DETERSIONE DI STRUMENTI E ATTREZZATURE CHIRURGICHE

BACTISAN WIPE® 2000 FP Dispositivo Medico CE 0373 **Principio Attivo:** Didecildimetil ammonio cloruro O-fenil-fenolo	**SALVIETTE DISINFETTANTI** In tessuto non tessuto, imbibite di soluzione disinfettante.	Decontaminazione di dispositivi medici prima della pulizia e sterilizzazione. Disinfezione di attrezzature ospedaliere e ambulatoriali. Disinfezione di piccole superfici, quali manipoli, ripiani porta strumenti nello studio dentistico	**CONFEZIONE** Flow-pack da 72 pz x 12 **Cod.Art.04LH0015**
ACT 340 PLUS® 2000 Dispositivo Medico CE 0051 **Principio attivo:** NaDCC	**DISINFETTANTE IN COMPRESSE EFFERVESCENTI** Peso per compressa: 3 g (Cloro disponibile: 22,2%-ppm666) **Consigliamo di alternare l'utilizzo del prodotto con ACT 340 BIOPLUS 2000**	Disinfezione e detersione di circuiti di aspirazione chirurgica nei riuniti odontoiatrici. Non schiumogeno e compatibile con tutti gli impianti. Indicato anche per la disinfezione della sputacchiera. **Diluizioni d'uso**: sciogliere 1-2 compresse in 1l d'acqua ed aspirare la soluzione ottenuta.	**CONFEZIONE** 150 cpr x 6 **Cod.Art.04FA0700**
ACT 340 BIOPLUS 2000 Detergente Disincrostante Miscela di ceppi batterici sporigeni ed enzimi naturali	**DISINCROSTANTE** Soluzione ad alto potere detergente. Profumazione: limone Soluzione concentrata. **Consigliamo di alternare l'utilizzo del prodotto con ACT 340 PLUS 2000**	Sanificazione e disincrostazione dei circuiti di aspirazione dei riuniti odontoiatrici. Elimina il biofilm che si viene a formare all'interno del circuito d'aspirazione. Prodotto totalmente innocuo per l'uomo e per l'ambiente. **Diluizione d'uso**: 5-10% per 1 litro d'acqua ed aspirare nel circuito idrico.	**CONFEZIONE** lt 1 x 12 **Cod.Art.04AM0030**
BACTIMPRESSION 2000 Dispositivo Medico CE 0051 **Principi Attivi:** Propionato di N,N-didecil-N-metilpoli(ossietil)ammonio + clorexidina + enzimi	**DISINFETTANTE** Soluzione acquosa concentrata senza aldeidi per impronte dentali. Disinfettante ad ampio spettro d'azione.	Decontaminazione e detersione di impronte in silicone, alginato, polietere e polisolfuro, rispettando le caratteristiche di stabilità dimensionale e di compatibilità con i gessi. **Diluizione d'uso:** 0,5% (5ml) in 1l d'acqua per 15 min., 5% (50ml) in un 1l per 1 min. per le impronte in alginato.	**CONFEZIONE** lt 1 x 12 **Cod.Art.04AM0025**

DEODORANTI PER TESSUTI E TENDAGGI

ATLANTIC BREEZE **Deodorante** No Gas	**FRAGRANZA** • Fiorita • Agreste • Muschiata • Pino	**PIRAMIDE OLFATTIVA** **Note di testa:** Foglie di Violetta, Note acquatiche **Note di cuore:** Legno di Cedro, Pino, Geranio **Note di fondo:** Muschio Bianco	**CONFEZIONE** ml 350 x 6 **Cod.Art. 17LH0100**
GREEN BUTTERFLY **Deodorante** No Gas	**FRAGRANZA** • Fruttata • Verde • Muschiata • Cedro	**PIRAMIDE OLFATTIVA** **Note di testa:** Mela, Bergamotto, Note Marine **Note di cuore:** Tè, Mughetto, Menta **Note di fondo:** Legno di Cedro, Ambra, Muschio Bianco	**CONFEZIONE** ml 350 x 6 **Cod.Art. 17LH0110**
ORIENTAL MOON **Deodorante** No Gas	**FRAGRANZA** • Fiorita • Legnosa • Muschiata • Vanigliata	**PIRAMIDE OLFATTIVA** **Note di testa:** Agrumi di Sicilia, Orchidea Nera **Note di cuore:** Gelsomino, Sandalo, Ambra **Note di fondo:** Muschio Bianco, Bacche di Vaniglia	**CONFEZIONE** ml 350 x 6 **Cod.Art. 17LH0120**
PETIT JARDIN **Deodorante** No Gas	**FRAGRANZA** • Agrumata • Verde • Fiorita • Speziata	**PIRAMIDE OLFATTIVA** **Note di testa:** Carote, Pompelmo, Mango **Note di cuore:** Arancia, Peonia, Giacinto, Loto **Note di fondo:** Iris, Labdano, Cannella	**CONFEZIONE** ml 350 x 6 **Cod.Art. 17LH0130**
SEA SALT **Deodorante** No Gas	**FRAGRANZA** • Agrumata • Verde • Muschiata • Speziata	**PIRAMIDE OLFATTIVA** **Note di testa:** Note marine, Foglie d'Alloro, Limone **Note di cuore:** Eucalipto, Menta, Lavanda **Note di fondo:** Note speziate, Note Legnose, Ambra	**CONFEZIONE** ml 350 x 6 **Cod.Art. 17LH0140**

DISINFEZIONE MANI E CUTE

LH SOAP PMC – Reg.Min.Sal. nr. 18796 **Principio Attivo:** Benzalconio cloruro	**SAPONE LIQUIDO DISINFETTANTE** pH= 6,0 ± 0,5 Profumo: Latte-Miele	Antisettico – Antibatterico ad azione detergente per: Cute – Mani- Piedi Impiego in ambiente sanitario, comunità ed alimentare.	**CONFEZIONI** lt 1 x 12 **Cod.Art.06LH0011** lt 5 x 4 **Cod.Art.06LH0012**
LH DERMOWASH PMC – Reg.Min.Sal. nr. 19302 **Principio Attivo:** Clorexidina digluconato	**SAPONE ANTISETTICO** Ad azione profonda – Clorexidina g 2 pH = 6,5 ± 0,5 Profumo: Fiorito	Antisettico-Antibatterico da utilizzarsi preferibilmente quando è richiesta anche un'azione detergente: • lavaggio chirurgico delle mani • pronto soccorso • lavaggio di pazienti prima dell'intervento chirurgico; • pulizia ed antisepsi esterna in Ostetricia e Ginecologia.	**CONFEZIONI** lt 1 x 12 **Cod.Art.06LH0032**
LH DERMOSCRUB PMC – Reg.Min.Sal. nr. 18925 **Principio Attivo:** Clorexidina digluconato Alcool etilico	**DETERGENTE DISINFETTANTE BATTERICIDA** Ad ampio spettro Clorexidina g 4 pH = 5,5 ± 0,5 Profumo: Fiorito	Antisettico - Antibatterico da utilizzarsi preferibilmente quando è richiesta anche un'azione detergente: • lavaggio chirurgico delle mani • pronto soccorso • disinfezione di emergenza delle mani • lavaggio di pazienti prima dell'intervento chirurgico	**CONFEZIONI** lt 1 x 12 **Cod.Art.06LH0041**
LH NEW CLOREXIDINA PMC – Reg.Min.Sal. nr. 19104 **Principio Attivo:** Clorexidina digluconato Alcool etilico	**DISINFETTANTE IDROALCOLICO PER CUTE INTEGRA** Pronto all'uso Clorexidina g 0,5 pH = 6,5 ± 0,5 Tempo di contatto 1 minuto Profumo: Fiorito	Antisettico - Antibatterico per la disinfezione delle mani e della pelle in genere. È indicato per la disinfezione delle mani del personale della sala operatoria e del personale sanitario in genere. Può essere impiegato per la disinfezione della zona su cui si interviene chirurgicamente.	**CONFEZIONE** lt 1 x 12 **Cod.Art.06LH0052**
MEDICAL ICE Dispositivo Medico - CE **Principio Attivo:** Miscela di sali azotati	**GHIACCIO ISTANTANEO** Buste TNT - PE Pronto all'uso	**PRONTO SOCCORSO** Trova utile impiego nei settori: ospedaliero, odontoiatrico, ortopedia, traumatologia, sportivo e nella pubblica assistenza	**CONFEZIONE** gr 225 x 25 buste **Cod.Art.09DP0025**

GEL MANI

Formato	500 ml

DATI GENERALI DEL PRODOTTO COSMETICO

Gel mani che garantisce una doppia azione igienizzante grazie alla sua speciale formula con il **70% di Alcol** e **Olio essenziale di Tea Tree**. Arricchito con **Gel di Aloe BIO** ad azione idratante, lascia la pelle pulita e igienizzata.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto	**Gel limpido**
Stato fisico	**Liquido**
Colore	**Incolore**
Odore	**Profumato**
Viscosità	**1500-3000 mPas**
Densità	**0.89 ± 0.02 g/mL**
pH	**5.0-6.0**
Alcool etilico grado cosmetico denaturato TIPO B	**70% v/v**
Nichel/Cobalto/Cromo	**< 1 ppm**

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE

Carica microbica mesofila aerobia	**< 10 Cfu/1g**
Muffe e lieviti	**< 10 Cfu/1g**

ETICHETTATURA INCI [CTFA]

Alcohol denat., Aqua [Water], Glycerin, Aloe barbadensis leaf juice (*), Melaleuca alternifolia (Tea tree) leaf oil, Carbomer, Parfum [Fragrance], Limonene, Linalool, Citric acid, Triethanolamine.

(*) da agricoltura biologica/ from organic agriculture

Come lavarsi **correttamente le mani?**

Un veloce risciacquo non basta. Ci sono delle regole da rispettare.

Togli gli anelli. Per i micro organismi le porzioni di cute coperte da monili rappresentano aree confortevoli in cui crescere

Usa un **sapone** preferibilmente **liquido** (sulle saponette si annidano i germi)

Metti le mani sotto l'acqua calda e **insapona** i polsi, i palmi, il dorso delle mani, le dita e lo spazio sotto le unghie

Sfrega le mani per circa **20 secondi** e poi risciacqua bene e a lungo. Hai capito bene: 20 secondi. Lo so, per un bambino è un tempo infinito. Per convincere i più piccoli a rientrare nelle tempistiche ideali, fagli cantare la canzoncina "Tanti auguri a te" per due volte. Funziona!

Asciuga le mani con una **carta usa** e **getta**, un asciugamano pulito o con un dispositivo d'aria calda

Piccola accortezza:
per non vanificare le tue azioni chiudi il rubinetto con le **mani protette** da una **salvietta**

TAPPETI DECONTAMINANTI ANTIBATTERICI

ANTI-BATTERICO

ANTI-MUFFA

ANTI-POLVERE

I NOSTRI PRODOTTI

DIMENSIONI

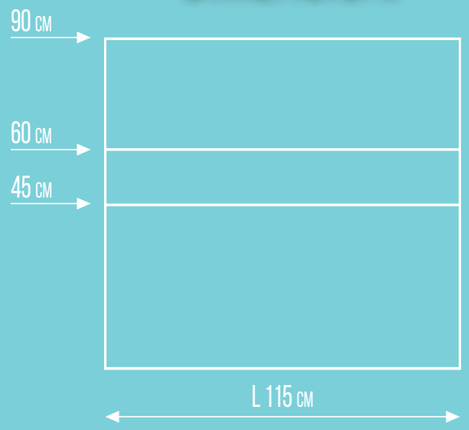

PERSONALIZZAZIONE

PACK

Area personalizzazione L 17 x H 7 cm

TAPPETO

Area personalizzazione Ø 18 cm

115x60

ANTIBATTERICO

TAPPETO DECONTAMINANTE

CODICE	*COLORE*	*DIMENSIONI*
3L41-B	BLU	115 X 45 CM
3L61-B	BLU	115 X 60 CM
3L91-B	BLU	115 X 90 CM

TAPPETO ANTIBATTERICO

CODICE	*COLORE*	*DIMENSIONI*
3L41B-B	BLU	115 X 45 CM
3L61B-B	BLU	115 X 60 CM
3L91B-B	BLU	115 X 90 CM

115x45

ANTIBATTERICO

TAPPETINO con 30 strati con indicatore e fondo adesivo totale. 8 pezzi per confezione.

I NOSTRI CLIENTI:

- OSPEDALI PUBBLICI
- CASE DI CURA PRIVATE
- AMBULATORI MEDICI PRIVATI
- LABORATORI DI ANALISI CLINICHE
- CENTRI DI ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA
- FARMACIE
- INDUSTRIE FARMACEUTICHE
- INDUSTRIE ALIMENTARI
- INDUSTRIE COSMETICHE
- INDUSTRIE PRODOTTI MEDICALI
- LABORATORI DI ELETTRONICA
- RIVENDITORI DI PAVIMENTI
- CENTRI SPORTIVI
- CENTRI RICERCA

L'uso del tappeto decontaminante e battericida riduce notevolmente l'apporto di microrganismi e per questo può essere considerato come un presidio di grande utilità soprattutto nelle zone di accesso di aree a rischio quali ad esempio sale operatorie e reparti ospitanti pazienti immunodepressi.

Spesso viene sottovalutato l'**apporto di microrganismi mediante il calpestio** o il passaggio dei carrelli in zone limitrofe alle aree ad alto rischio o addirittura in quelle stesse aree nelle quali si deve richiedere il minimo possibile della contaminazione ambientale.

Il pericolo maggiore è quello di portare in tali zone, mediante il passaggio, o di sollevare mediante il calpestio o il passaggio dei carrelli, microrganismi resistenti, e che poi, per via aerea, possono **costituire una fonte d'infezione**.

Per cercare di ovviare a questo tipo di contaminazione **MedicalWay ha messo a punto tappeti decontaminanti e battericidi costituiti da fogli di polietilene additivati con benzoisothiazolina**.

Il nostri tappeti decontaminanti e battericidi sono dispositivi medici CE di classe 1, non semplicemente un tappeto cattura polveri ma un dispositivo con ottime capacità biocide.

INDISPENSABILI DOVE SI RICHIEDE LA MASSIMA IGIENE E DECONTAMINAZIONE

In questo Studio dentistico è presente un
tappeto adesivo decontaminante
di colore blu che
VI PREGHIAMO DI CALPESTARE
in quanto ha il compito di
***trattenere le impurità** presenti sotto le scarpe*
provenienti dall'ambiente esterno
è un dispositivo medico CE di classe 1
*ad **azione battericida**.*

Questo è un accorgimento utilizzato
in alcuni ospedali e nei centri medici all'avanguardia
affinché l'ambiente sanitario
*resti il **più pulito possibile***
a tutela della Vostra salute.

Lo studio ringrazia per la collaborazione

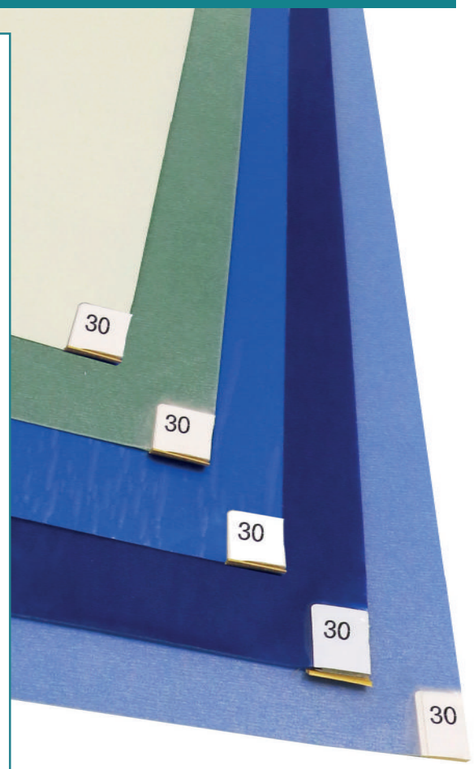

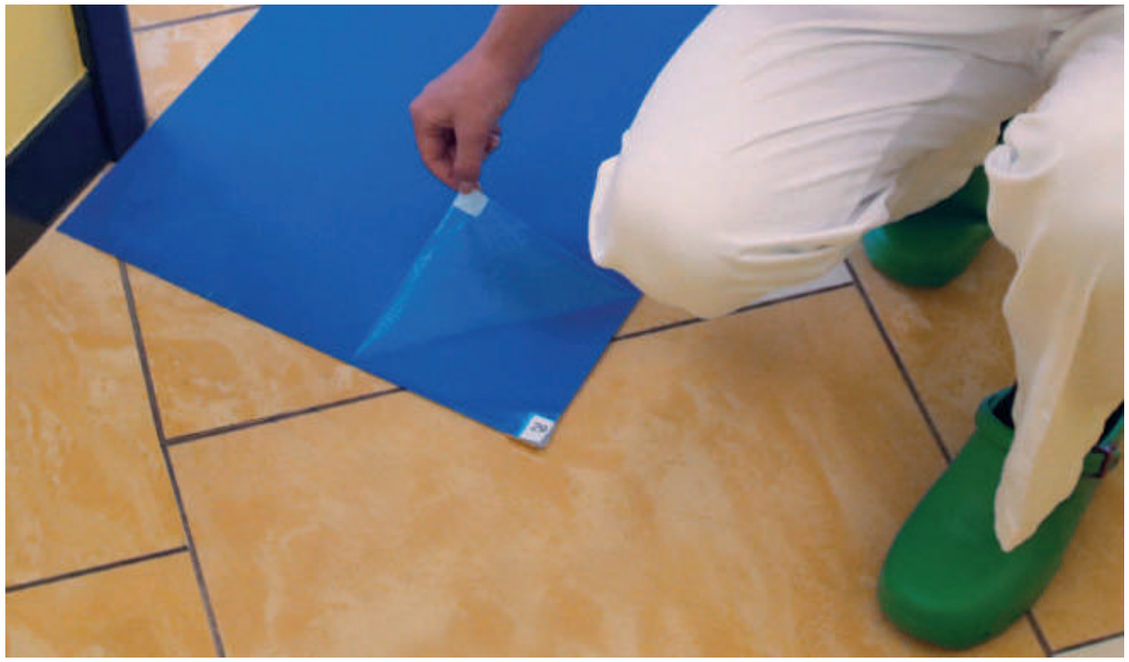

ISO 22196:2011 Antimicrobial Test Certificate

This is to certify that

Medical Mat with Biomaster (AT300 @ 0.3%)

supplied by

CBS Medical Srl

has been tested to ISO 22196:2011 standards and shown to reduce

Acinetobacter baumanni by **> 99,999 %**

Pseudomonas aeruginosa by **> 99,999 %**

Listeria monocytogenes by **> 99,999 %**

Klebsiella pneumoniae by **> 99,999 %**

Enterococcus faecium by **> 99,992 %**

Date of test: January 17, 2022

Test laboratory: 3A Laboratori SRL, Padova. Registered in Italy 04296730288

Certificate Number: 22LA00323; 22LA00324; 22LA00325; 22LA00326; 22LA00327

Sandra Salvò
Technical Manager
Sandra Salvò

Biomaster PROTECTED

Medical Way

Vetri, Specchi e Superfici Lavabili

40 Spray Professional

Schiuma detergente ideale per vetri e specchi

Schiuma detergente, sgrassante, brillantante per la pulizia di tutte le superfici lavabili ed eccezionale su vetri e specchi. Itidet 40 Spray Professional forma una schiuma attiva che aggrappandosi alla superficie è in grado di eliminare ogni tipo di sporco. Evapora rapidamente e non lascia aloni.

Codice	Confezione
E327612X1	BO 12 x 600 ml

Vetri, Specchi e Superfici Lavabili

40 Light

Detergente per vetri e cristalli

Itidet 40 light è un detergente pronto all'uso specifico per la pulizia di vetri, specchi, cristalli, vetrine, piastrelle, superfici laccate. Elimina i residui di sporco e polvere, asciuga rapidamente lasciando la superficie lucida e brillante senza traccia di aloni o striature. La particolare formulazione garantisce un'azione antiappannante e antirideponente dello sporco. Vetri e cristalli rimangono puliti più a lungo.

Codice	Confezione
D228912X750	FL 12 x 750 ml

ACIDIC — NEUTRAL — BASIC

pH 6.5

40 Liquido

Detergente sgrassante e brillantante con effetto antipolvere e antipioggia

Detergente, sgrassante brillantante per la pulizia di tutte le superfici lavabili ed eccezionale su vetri e specchi. Itidet 40 evapora rapidamente e non lascia aloni.

Codice	Confezione
D226512X1	FL 12 x 750 ml

ACIDIC — NEUTRAL — BASIC

pH 10

Codice	Confezione
EN327612X1	BO 12 x 500 ml

Energy Spray

Potente sgrassatore in schiuma spray adatto per tutte le superfici

Schiuma con potente effetto sgrassante e pulente. Adatto per pulire a fondo tutte le superfici ed in particolare quelle inaccessibili. Efficace su grasso, unto, inchiostri e macchie.

63 Melaceto

Pulitore universale pronto all'uso con antibatterico

Pulitore universale pronto all'uso con aceto naturale ed antibatterico. In cucina è ideale per la pulizia di frigoriferi, pensili, cappe e fornelli. In bagno è adatto per pulire ceramiche, sanitari e rubinetteria. Rilascia una gradevole profumazione persistente.

Codice	Confezione
D367112X1	FL 12 x 750 ml

Prodotti per la pulizia
a livello professionale
destinati a coloro
che pretendono il massimo.

Medical Way

63 Limone di Capri

Detergente pronto all'uso con antibatterico

Detergente universale pronto all'uso con antibatterico. In cucina è ideale per la pulizia di frigoriferi, pensili, cappe e fornelli. In bagno è adatto per pulire ceramiche, sanitari e rubinetteria. Rilascia una gradevole profumazione al limone di Capri.

Codice	Confezione
D368012X1	FL 12 x 750 ml



Strong

Detergente per sporco ostinato ed inchiostri

Speciale formulazione non abrasiva di detergenti e agenti antimacchia per la rimozione di inchiostro, grassi e sporco ostinato da superfici laminate, in plastica, in acciaio, vetrificate. Prodotto pronto all'uso ideale anche per rimuovere colle ed etichette.

Codice	Confezione
D235512X1	FL 12 x 750 ml

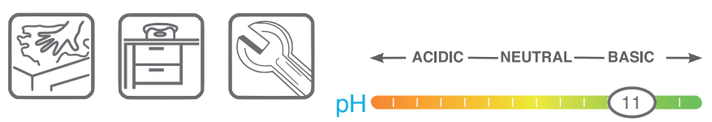

Deodor Melaverde

Detergente sgrassante per pavimenti. Profumo melaverde

Detergente sgrassante concentrato per tutti i pavimenti e superfici lavabili. Neutralizza gli odori rilasciando una grande profumazione alla mela verde e non necessita di risciacquo.

Codice	Confezione
D2267112X1	FL 12 x 1 lt



San

Detergente sanificante con antibatterico

Detergente contenente sali quaternari di ammonio ad azione battericida. Ideale per pavimenti di mense, cucine, bagni, scuole, istituti. Deodora e rilascia una profumazione persistente alla citronella.

Codice	Confezione
D232812X1	FL 12 x 1 lt

Deodor Colonia

Detergente igienizzante con antibatterico. Intensa profumazione

Detergente per pavimenti e superfici lavabili concentrato ed igienizzante.
Contiene una miscela di neutralizzanti degli odori che impartiscono una piacevole fragranza di colonia agli ambienti e alle superfici.

Codice	Confezione
D2267212X1	FL 12 x 1 lt

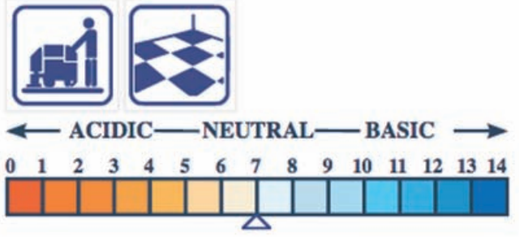

Pavimenti Gel Intensa

Detergente concentrato a schiuma frenata

Product Description

Il pavimenti gel è un detergente concentrato per qualsiasi tipo di superficie. Pulisce e sgrassa velocemente senza formare schiuma. Rilascia nell'ambiente una piacevole e persistente profumazione alla lavanda.

Additional Information

Confezionamento	*fl-12-x-750-ml,*

COD: D2262 Categoria: Pavimenti e Sanificanti
Tag: Lavasciuga, Pavimenti

Disinfettanti e biocidi

Isosan

Detergente disinfettante superconcentrato PMC n.12190

ISOSAN, disinfettante con Presidio Medico Chirurgico, è un germicida altamente concentrato che può essere impiegato con efficacia ovunque occorra disinfettare e cioè in ospedali, scuole, comunità, industrie, impianti sportivi e attrezzature.

Codice	Confezione
D236012X1	FL 6 x 1 lt



Bagno

Codice	Confezione
D242612X1	FL 12 x 1 lt

ITICHLOR GEL

Detergente sgrassante al cloro

Detergente gel cloro-attivo ad effetto sgrassante e igienizzante. Il prodotto in gel aderisce alle pareti verticali pulendo a fondo senza graffiare. Idoneo ai piani di lavoro H.a.c.c.p.

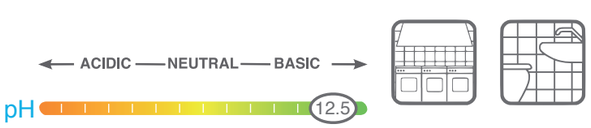

Detergenti Profumanti

Codice	Confezione
D245012X1	FL 12 x 750 ml

Itisir Gentile

Fragranza deodorante e detergente con note alla melaverde

Itisir Fragranza Gentile, oltre a garantire una fresca profumazione alla melaverde e fresia piacevolmente persistenti, è un detergente per superfici in marmo, ceramica, grès, linoleum, resina, legno e parquet. La sua azione antistatica lo rende ottimo per spolverare mobili e suppellettili, proteggendoli dalla rideposizione dello sporco e della polvere.

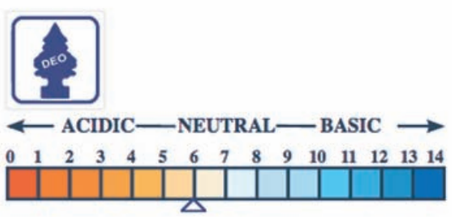

Itidor Elettra

Deodorante e cattura odori al limone

Product Description

Itidor è un potente cattura odori abbinato a fragranze gradevoli e persistenti. Elimina tutti i cattivi odori (fumo, fritto, bagno, animali, muffa, umidità ecc.), senza coprirli, da qualsiasi tipo di ambiente, anche in aree dedicate ad animali domestici lasciando l'ambiente fresco e profumato. Grazie alla speciale formulazione è ideale anche per neutralizzare gli odori da superfici e tessuti d'arredo come tende e divani. La fragranza è stata studiata per essere utilizzata nelle cucine professionali.

Additional Information

Confezionamento *fl-12-x-750-ml,*

COD: D2465 Categoria: Detergenti Profumanti
Tag: Deodorante

N.B.: TUTTI I PREZZI DI QUESTO CATALOGO SI INTENDONO IVA ESCLUSA

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE

DECONTAMINAZIONE, DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE DELLO STRUMENTARIO IN AMBITO ODONTOIATRICO

Le seguenti procedure operative sono finalizzate all'implementazione negli ambulatori odontoiatrici di trattamenti di decontaminazione e pulizia, adatti a ridurre i residui biologici su strumenti e strumentario rotante e rendere efficace il successivo processo di sterilizzazione, salvaguardando l'integrità delle frese e la superficie degli strumenti.

PROTOCOLLO

1. Ammollo/decontaminazione
2. Lavaggio in ultrasuoni
3. Risciacquo
4. Lavaggio in termo disinfettore
5. Controllo visivo
6. Sterilizzazione

PROCEDURA

FASE 1

AMMOLLO DECONTAMINAZIONE

Appena terminata la seduta, immergere lo strumentario in una soluzione di **liquido disinfettante biodegradabile** per almeno 15 minuti. Il principale obiettivo di questa fase è la **decontaminazione** dello strumentario potenzialmente infetto. Si realizza inoltre anche la **re-idratazione** dei residui organici per **favorire la rimozione nelle fasi successive. Da evitare disinfettanti o detergenti ad alto contenuto di cloro (se vengono utilizzati, la durata del trattamento non deve superare i 30 minuti) o contenenti acido ossalico.**

EFFETTI NEGATIVI
IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE NORME

Corrosione perforante e corrosione da contatto.

ATTENZIONE!
NON TRATTARE INSIEME STRUMENTI DI MATERIALI DIVERSI.

FASE 2

LAVAGGIO IN ULTRASUONI

Lavaggio dello strumentario in **ultrasuoni** per 15 minuti a circa 40 °C (l'acqua si percepisce tiepida immergendovi un dito). Inserire le frese/files all'interno del becker e avviare gli ultrasuoni. Inserire sempre gli appositi contenitori per frese/files nei **cestini grigliati** in dotazione all'apparecchio; nessun oggetto o contenitore deve venire a contatto con le pareti della vasca ad ultrasuoni. **Ove possibile, separare gli strumenti in acciaio dagli strumenti in carburo di tungsteno.** Coprire la vasca durante l'uso con il coperchio in dotazione. L'elevata capacità degli ultrasuoni di penetrare cavità e avvallamenti, garantisce una **pulizia qualitativamente superiore** ed una **diminuzione del rischio di punture accidental**i rispetto al lavaggio manuale mediante spazzolatura.

EFFETTI NEGATIVI
IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE NORME

Residui visibili e invisibili che compromettono le successive fasi di decontaminazione degli strumenti.

FASE 3

RISCIACQUO

Risciacquare bene le frese sotto acqua corrente evitando gli schizzi. Il risciacquo permette infatti di **rimuovere sia i residui** di soluzione di lavaggio, sia i residui biologici parzialmente distaccati dopo la procedura ad ultrasuoni. Il risciacquo accurato dei dispositivi sottoposti al lavaggio mediante ultrasuoni è altrettanto importante rispetto al lavaggio stesso. **Dopo il risciacquo asciugare perfettamente gli strumenti con carta assorbente o getto d'aria.**

EFFETTI NEGATIVI
IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE NORME

Corrosione delle parti rimaste contaminate, eventuale fissaggio delle proteine alle temperature più elevate delle successive fasi, formazione di macchie.

FASE 4

TERMO DISINFEZIONE (AUTOCLAVE)

Inserire lo strumentario nel termo disinfettore, **utilizzando gli appositi cestini o supporti.** Il lavaggio, o detersione, dei DM rappresenta un requisito essenziale per la sterilizzazione. Ha lo scopo di ridurre di oltre il 90% l'entità della contaminazione microbica e di rimuovere il materiale organico ,la cui persistenza può ostacolare l'azione dell'agente sterilizzante e vanificare l'intero processo. **Uno strumento non pulito, anche se sottoposto a sterilizzazione, non garantisce il raggiungimento della sterilità**. Il lavaggio si avvale **dell'azione chimica o enzimatica** e, contemporaneamente, **non corrosiva** di un detergente **che deve essere impiegato rigorosamente alle concentrazioni e per i tempi di contatto raccomandati dal fornitore.**

EFFETTI NEGATIVI
IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE NORME

Macchie scure sulle frese e sugli strumenti manuali, formazione di ruggine.

ATTENZIONE!

Strumenti corrosi o arrugginiti provocano la contaminazione del ciclo d'acqua in autoclave con particelle di ruggine. In tutte le successive sterilizzazioni, queste particelle causeranno ruggine di apporto sugli strumenti intatti! Ricordarsi di effettuare la pulizia ed il controllo periodico dell'apparecchio!

FASE 5

CONTROLLO VISIVO ACCURATO

Al termine del lavaggio in termo disinfettore, è buona norma controllare lo stato delle frese e dei files con una **lente di ingrandimento dotata di fonte luminosa**. In presenza di materiale non rimosso (la procedura non è infallibile…), di ruggine o di piegature, si consiglia l'eliminazione dello strumento.

EFFETTI NEGATIVI
IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE NORME

Mancato o imperfetto funzionamento degli strumenti, impossibilità di un uso corretto durante l'intervento.

RACCOMANDAZIONI

a) Le frese e gli strumenti manuali nuovi *(cioè appena tolti dalla confezione originale) presentano residui oleosi di lavorazione che possono inquinare il campo operatorio e/o indurre reazioni da corpo estraneo o allergiche. Vanno quindi processati prima del loro iniziale utilizzo, come se fossero contaminati.*
b) *È consigliabile utilizzare, se possibile, per gli strumenti canalari e frese, in tutte le fasi della riprocessazione* ***(ammollo, lavaggio in ultrasuoni, meccanico e sterilizzazione) lo stesso contenitore, per evitare così manipolazioni inutili.***
c) *Può succedere, nel caso di strumentario a mano, che residui oleosi di lavorazione fuoriescano dagli snodi al momento dell'esposizione alle alte temperature dell'autoclave, vaporizzandosi con l'acqua dello strumento mal asciugato, ridepositandosi sottoforma di macchioline scure sullo strumento stesso. Saranno necessari in questo caso, un'accurata pulizia con un panno umido e la ripetizione del procedimento.*

DEFINIZIONI Termini e/o acronimi, definizioni, classificazione di Spaulding. Suddivide tutti i dispositivi medici e ogni strumento utilizzato in assistenza, a scopo diagnostico o terapeutico, in 3 categorie: CRITICI – SEMICRITICI – NON CRITICI in base all'entità del rischio di infezione che la loro utilizzazione comporta. È una classificazione proposta da Spaulding (1977) ed è tutt'ora riconosciuta valida a livello internazionale. Nello specifico: **I. ARTICOLI CRITICI**: strumenti introdotti nel sangue o in aree del corpo normalmente sterili, che vengono a contatto con cute e mucose non integre o che fanno parte di un campo sterile. Requisito richiesto STERILITA'. **II. ARTICOLI SEMICRITICI:** strumenti che vengono a contatto con mucose integre. Nella gran parte dei casi, una disinfezione di alto livello, garantisce, con un ragionevole grado di sicurezza che l'articolo è privo di microrganismi patogeni. Requisito richiesto STERILITA' DESIDERABILE. **III. ARTICOLI NON CRITICI:** strumenti e oggetti che solitamente non vengono a contatto con il paziente o entrano a contatto solo con la sola cute integra. Requisito richiesto PULIZIA. **D.P.I.**(Dispositivo di Protezione Individuale) : dispositivi destinati ad essere indossati e tenuti dall'operatore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi che potrebbero minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro. Rispondono a specifiche normative nazionale. **DETERGENTE:** prodotto composto da agenti chimici in grado di ridurre la tensione superficiale tra superficie e sporco e di mantenere le particelle di sporco in sospensione nell'acqua. **DISINFETTANTE:** composto chimico anti – microbico ad azione specifica e non selettiva in grado di agire su superfici ed oggetti con effetto decontaminante sui microrganismi patogeni fino a livelli di sicurezza. **DISPOSITIVI DI BARRIERA** (questa definizione comprende) : **Dispositivi Medici**: mascherina chirurgica, camice, guanti monouso. **Dispositivi Protezione Individuale**: calzature, visiera, occhiali, guanti. **Altri Dispositivi:** grembiule monouso, copri – scarpe. **Dispositivo Medico** (D.M.): strumento non farmacologico per diagnosi, prevenzione, controllo, terapia ed attenuazione di un problema di salute. Allo scopo di garantire che tutti i D.M. siano adeguatamente controllati in rapporto al rischio potenziale che potrebbe derivare al paziente da un loro mal funzionamento, vengono classificati in 4 classi, definite in ordine crescente di rischio: CLASSE I - CLASSE I sterile - CLASSE I funzioni di misura - CLASSE II - CLASSE II b - CLASSE III. **D.M. invasivi:** dispositivi che penetrano, anche solo parzialmente, nel corpo tramite un orifizio o una superficie corporea. **FILE ENDODONTICO**: strumento manuale o rotante a superficie tagliente, usato nella terapia endodontica per sagomare i canali radicolari. **FRESA DIAMANTATA**: strumento rotante a superficie abrasiva che lavora per usura, usata su smalto. **FRESA MULTILAMA**: strumento rotante a superficie tagliente, usata sulla dentina o sull'osso. **STRUMENTI MANUALI**: pinze, leve, porta – aghi, forbici, sonde, curettes, scollaperiosto, etc… e tutti gli strumenti che non necessitano di essere montati su un rotore per il loro utilizzo.

www.medicalway.it

Medical Way di Roberto Spano
Via Scandolara, 58/A - 31059 Zero Branco (TV)
Tel. 0422 488087 - Fax 0422 488748
medicalway14@gmail.com www.medicalway.it